


MEDVIE


Date du test: 09/07/2025 09:35:13  
Durée: 5mn 12s  
Type test: Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient   |                   | LI FALIN |
|-------------------|-------------------|----------|
| Date de naissance | 01/03/1973        |          |
| Age               | 52                |          |
| Société           | GPC               |          |
| ID                | 25070909194993559 |          |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690093     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

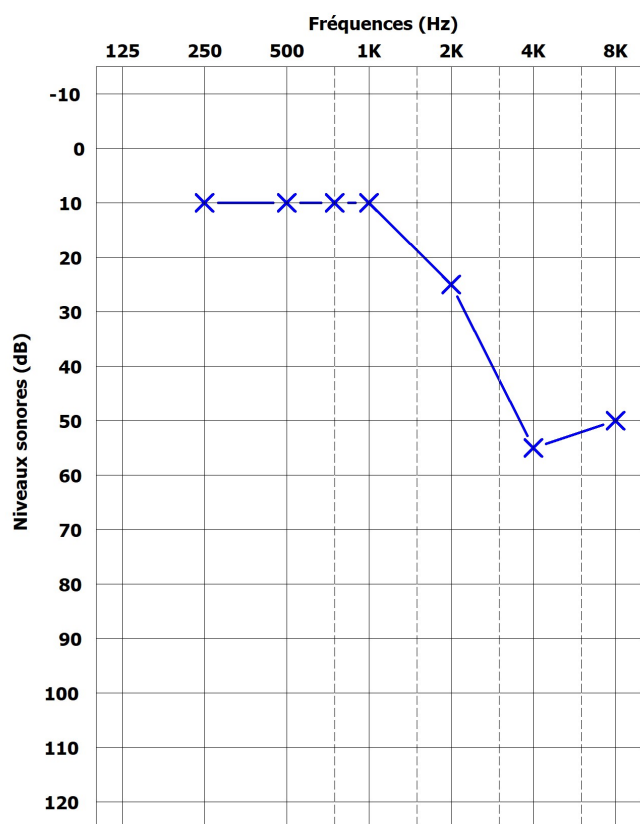

Oreille Gauche

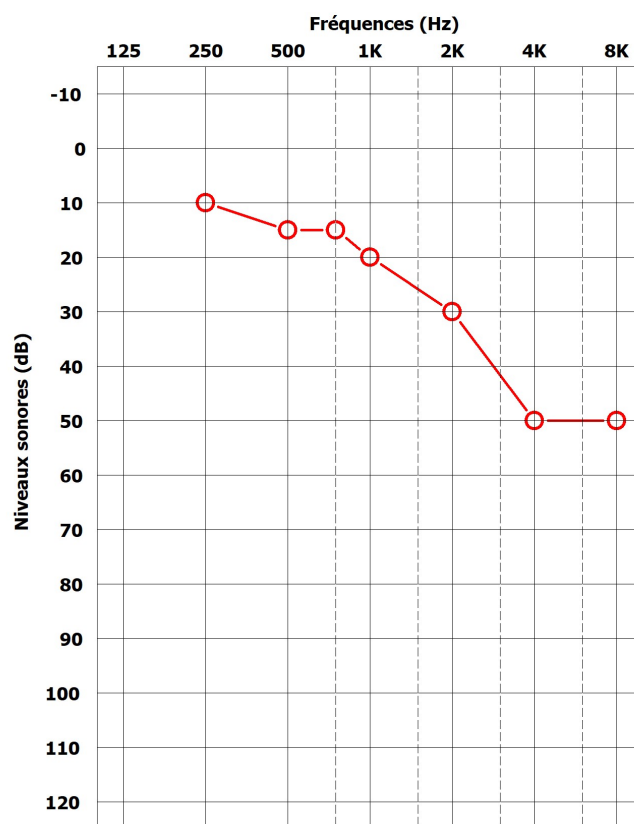

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 10  | 10  | 10  | 10 |     | 25 |    | 55 |    | 50 |
| CA Droit  |     | 10  | 15  | 15  | 20 |     | 30 |    | 50 |    | 50 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 25,0 dB | --- |
| CA Droit        | 28,8 dB | --- |

Notes