



Données Patient	
FOFANA MORLAYE	
Date de naissance	30/01/1983
Age	41
Société	
ID	24022309594303350

Date du test: 23/02/2024 10:05:48
Durée: 3mn 50s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

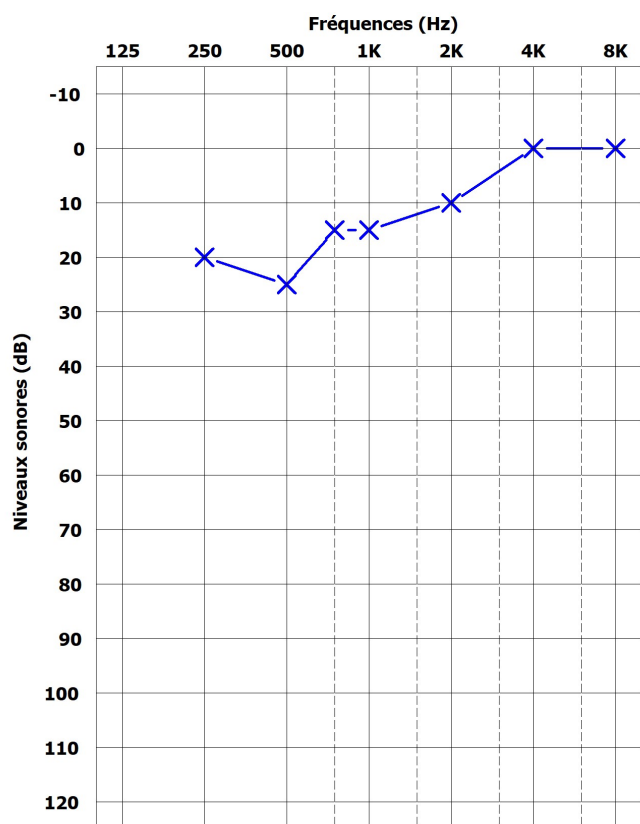

Oreille Gauche

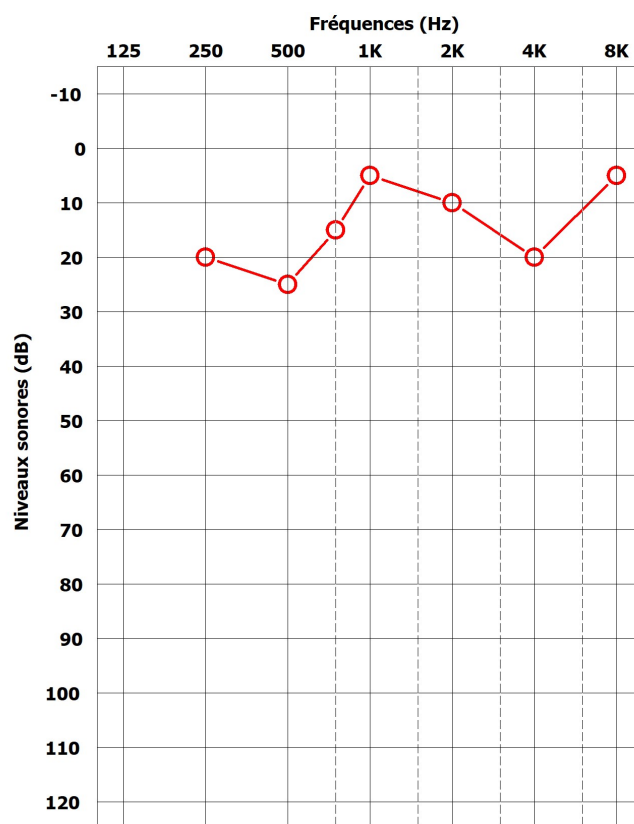

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	25	15	15		10		0		0
CA Droit		20	25	15	5		10		20		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes