

MEDVIE


Date du test: 25/03/2025 10:35:31

Durée: 5mn 32s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		AKOBI KAMAR DEEN
Date de naissance	30/08/1986	
Age	38	
Société	GPC	
ID	25032510272773177	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

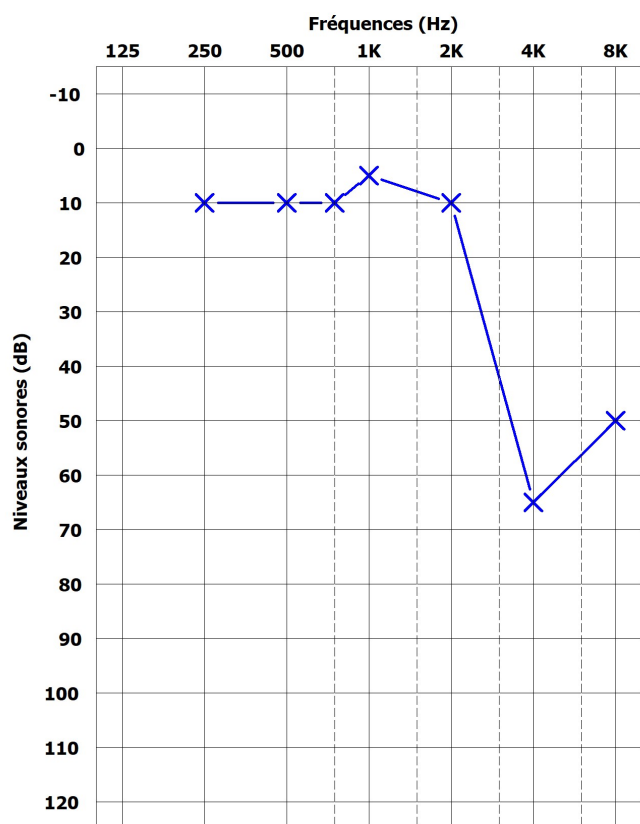

Oreille Gauche

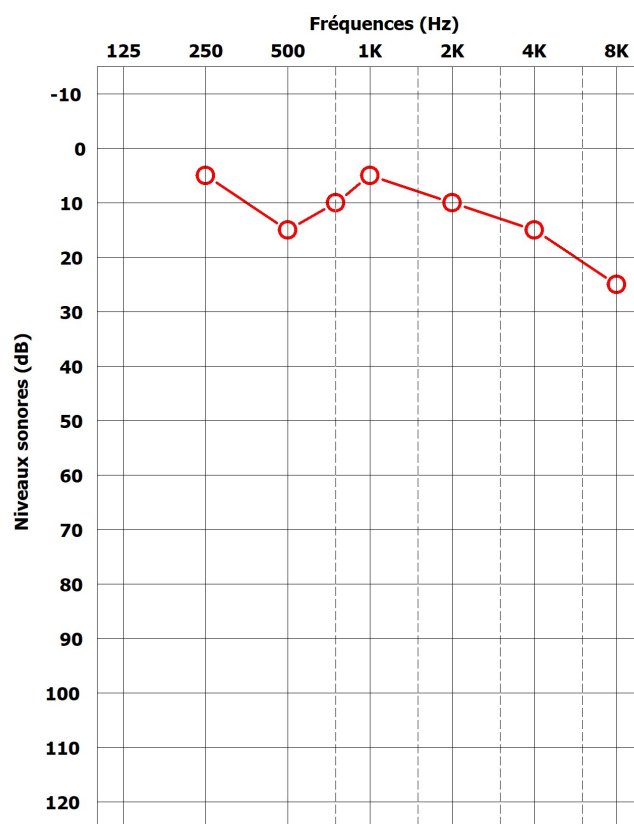

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	10	10	5		10		65		50
CA Droit		5	15	10	5		10		15		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes