


MEDVIE


Date du test: 15/06/2024 13:06:05

Durée: 3mn 55s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

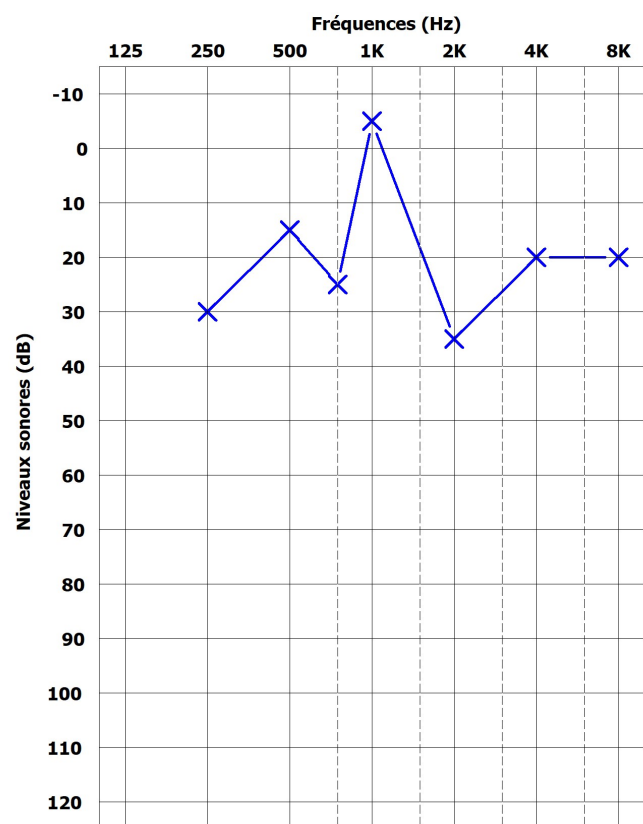

Oreille Gauche

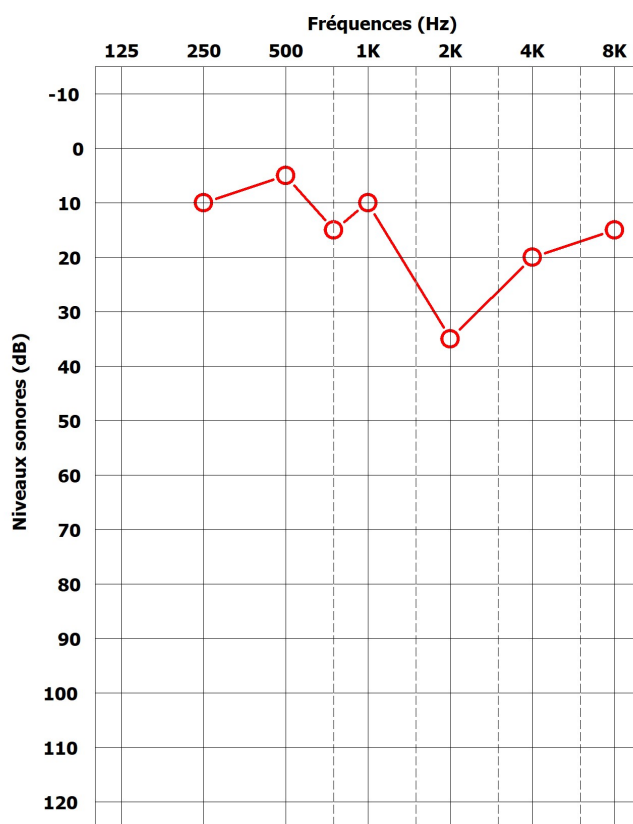

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	15	25	-5		35		20		20
CA Droit		10	5	15	10		35		20		15

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes

Données Patient

CAMARA Lansana

Date de naissance

01/07/1971

Age

52

Société

GPC

ID

24061513025430637

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690092

Date Calibration :

30/11/2021