


MED VIE


Date du test: 15/06/2024 18:16:39
Durée: 8mn 28s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SYLLA OUSMANE	
Date de naissance	01/07/1969
Age	54
Société	GPC
ID	24061518114569105

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

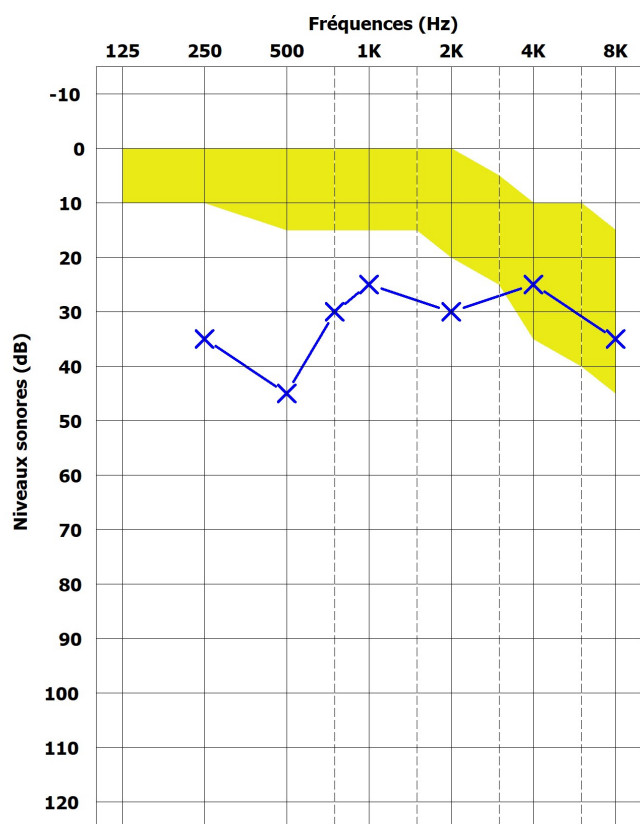

Oreille Gauche

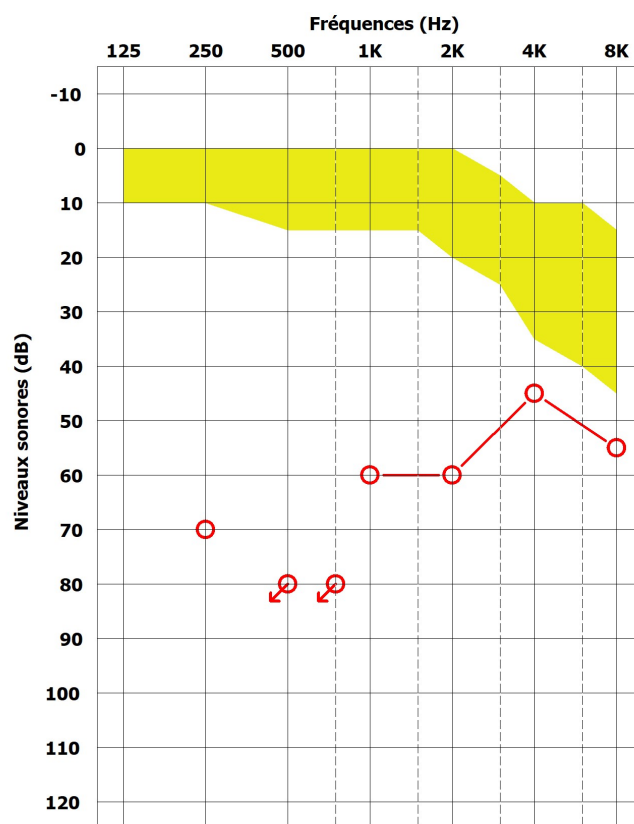

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	45	30	25		30		25		35
CA Droit		70	(80)	(80)	60		60		45		55

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	31,3 dB	---
CA Droit	---	---

Notes