


MED VIE


Date du test: 18/06/2024 10:44:17
Durée: 4mn 48s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	TRAORE TERNA
Date de naissance	01/03/1984
Age	40
Société	GPC
ID	24061810413832716

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

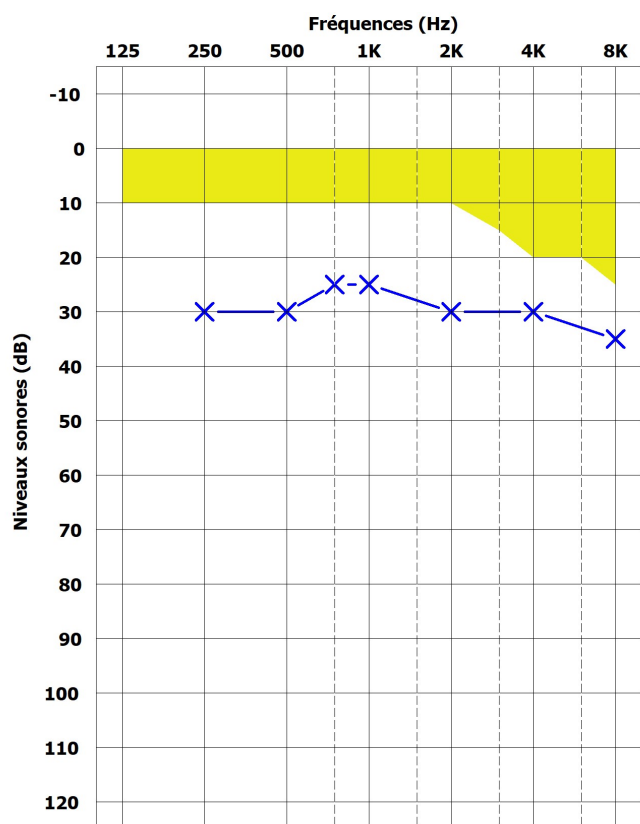

Oreille Gauche

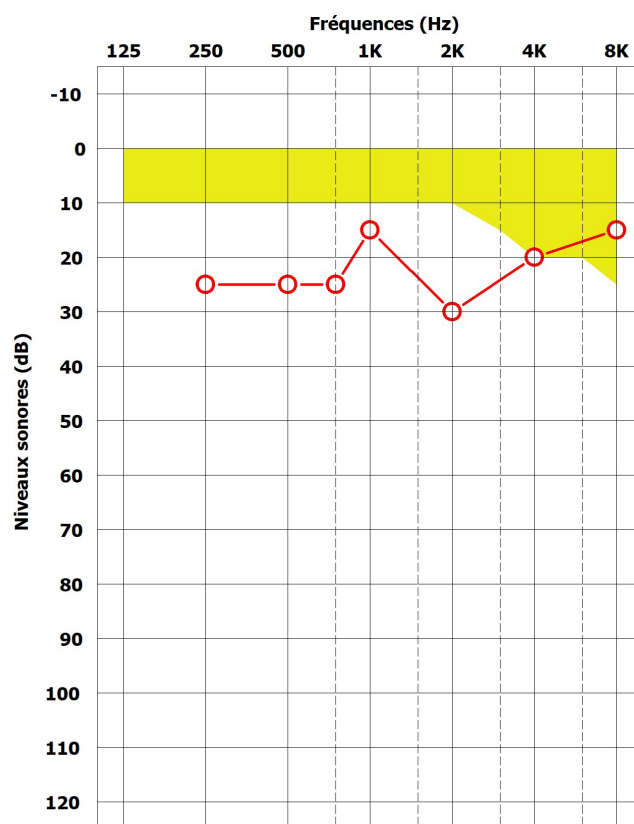

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	30	25	25		30		30		35
CA Droit		25	25	25	15		30		20		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	28,8 dB	---
CA Droit	22,5 dB	---

Notes