



Données Patient


SANE MAMADOU SALIOU

Date de naissance 01/07/1990
Age 33
Société MV/GPC/113
ID 24031213062283106


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 12/03/2024 16:30:14
Durée: 4mn 16s
Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

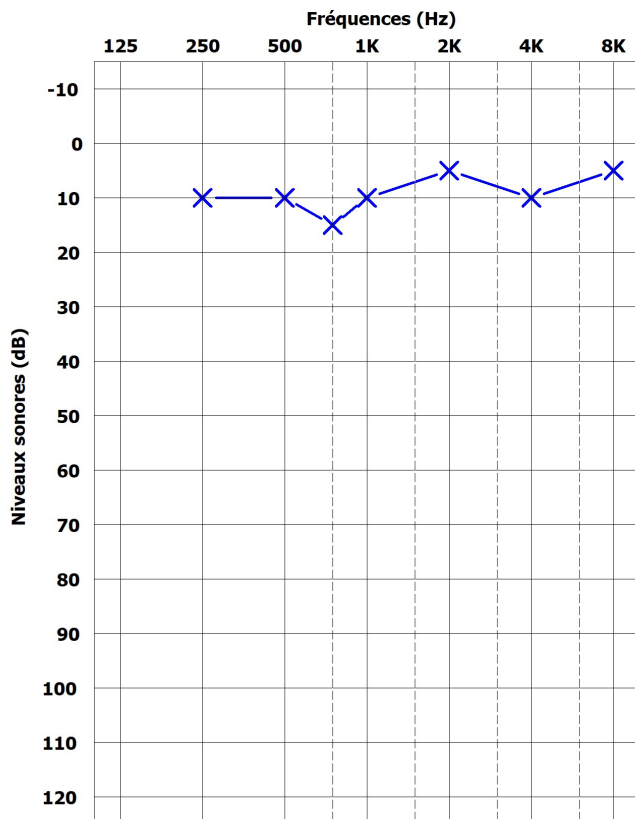

Oreille Gauche

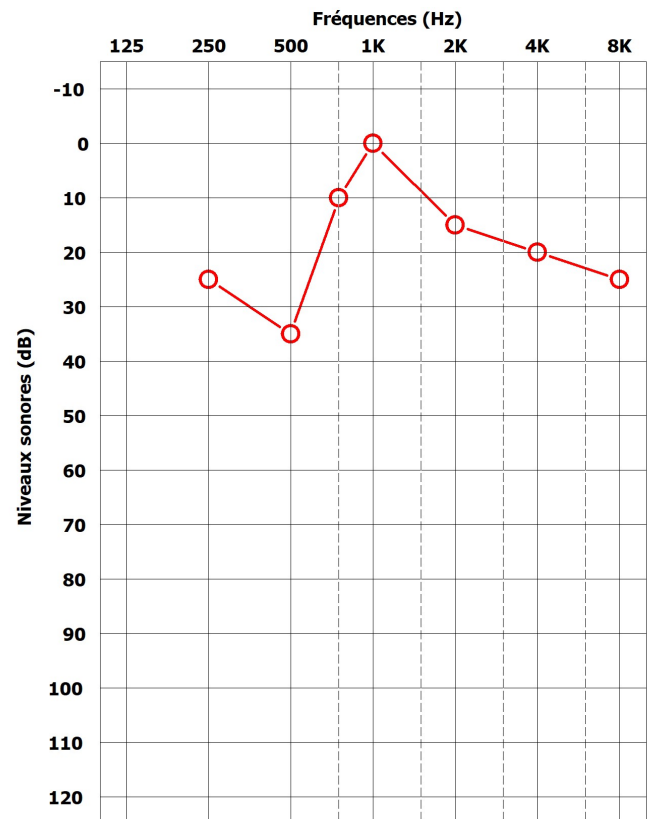

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	10	15	10		5		10		5
CA Droit		25	35	10	0		15		20		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes