



Données Patient		SOUHAM MUHAMED MAIMOUNA
Date de naissance	01/01/1989	
Age	35	
Société	MV/GPC/103	
ID	24031210253730190	

Date du test: 12/03/2024 10:27:39
Durée: 4mn 28s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

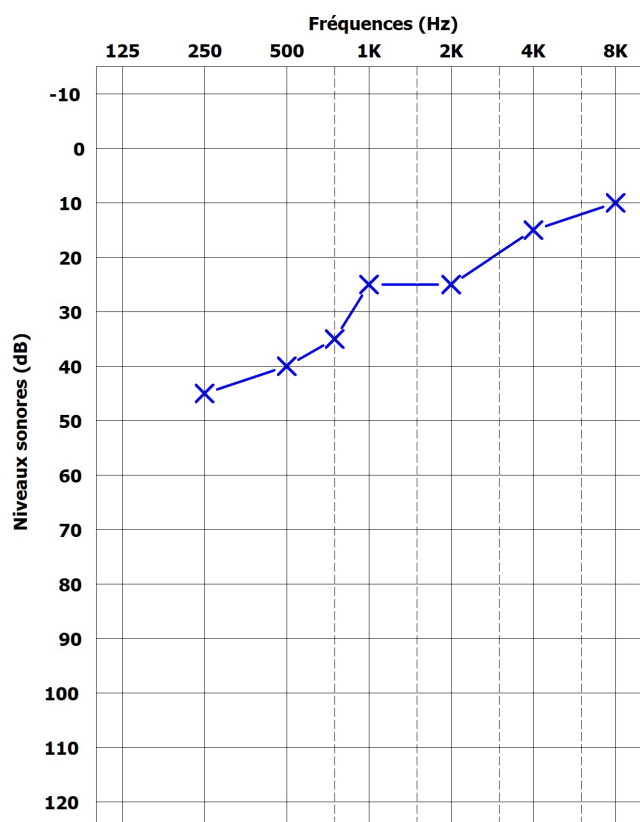

Oreille Gauche

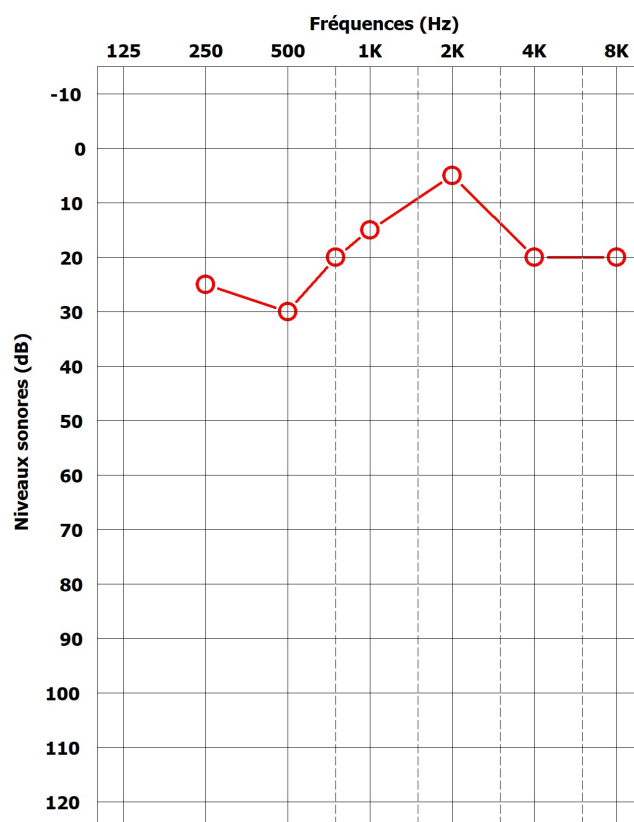

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		45	40	35	25		25		15		10
CA Droit		25	30	20	15		5		20		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	26,3 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes