


MEDVIE


Date du test: 23/05/2025 11:07:50

Durée: 7mn 04s

Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

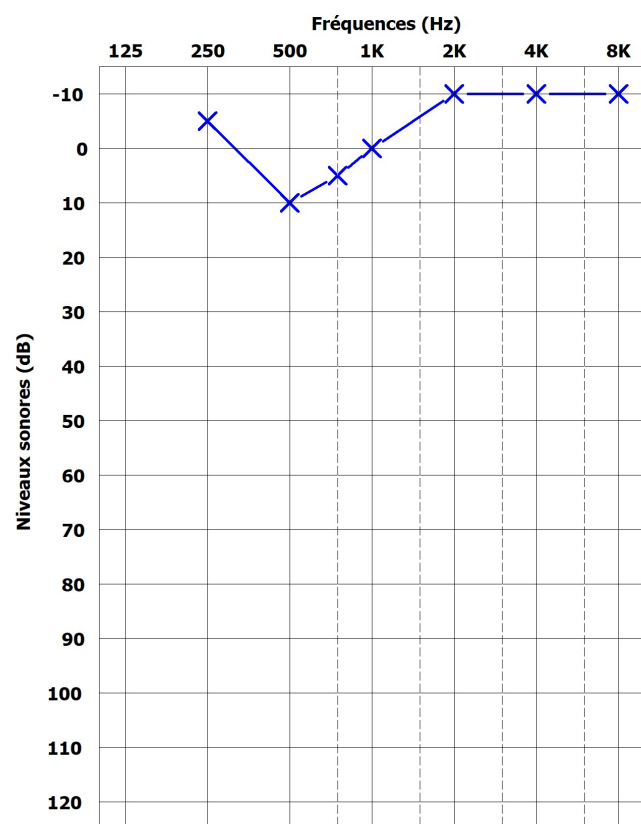

Oreille Gauche

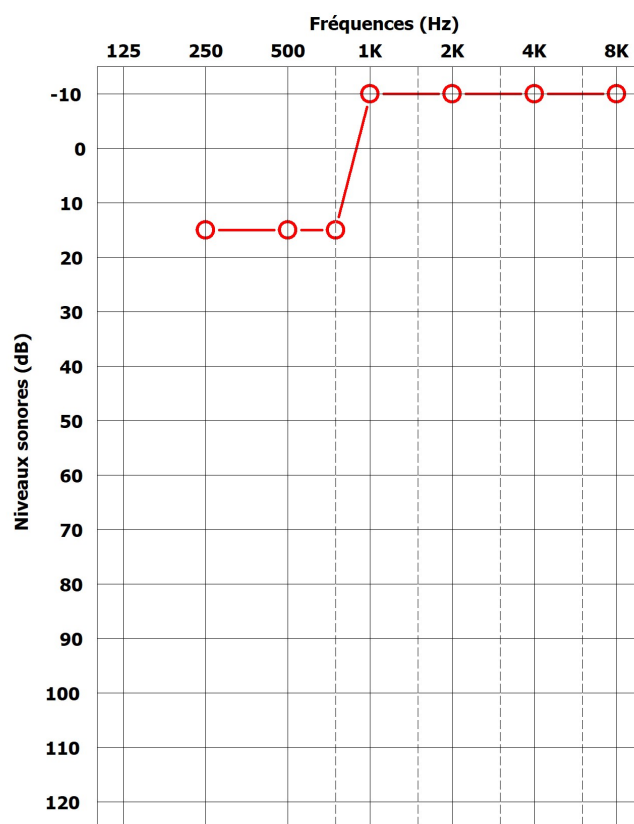

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k  | 1k5 | 2k  | 3k | 4k  | 6k | 8k  |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|
| CA Gauche |     | -5  | 10  | 5   | 0   |     | -10 |    | -10 |    | -10 |
| CA Droit  |     | 15  | 15  | 15  | -10 |     | -10 |    | -10 |    | -10 |

Calcul de perte

|           | PAM     | IPA |
|-----------|---------|-----|
| CA Gauche | -2,5 dB | --- |
| CA Droit  | -3,8 dB | --- |

Notes

| Données Patient   | BAH MAMADOU       |
|-------------------|-------------------|
| Date de naissance | 12/01/1970        |
| Age               | 55                |
| Société           | GPC               |
| ID                | 25052311051991272 |

| Audiomètre                     |
|--------------------------------|
| Type: Audio 820M V2,211        |
| Numéro de série: 2111EAT690093 |
| Date Calibration : 30/11/2021  |