

MEDVIE


Date du test: 28/04/2025 09:58:41

Durée: 8mn 17s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KOUROUMA KEMO	
Date de naissance	11/09/1994
Age	30
Société	GPC
ID	25042809560744635

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

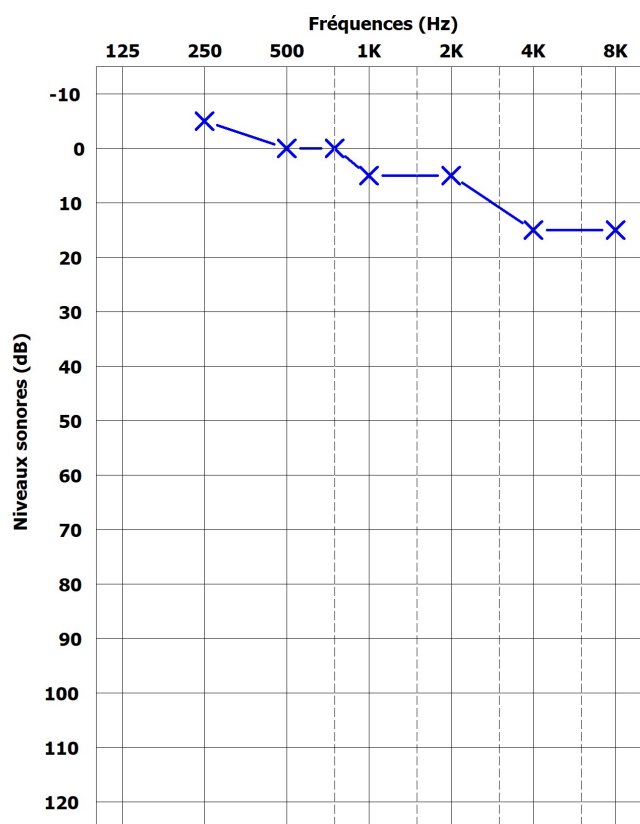

Oreille Gauche

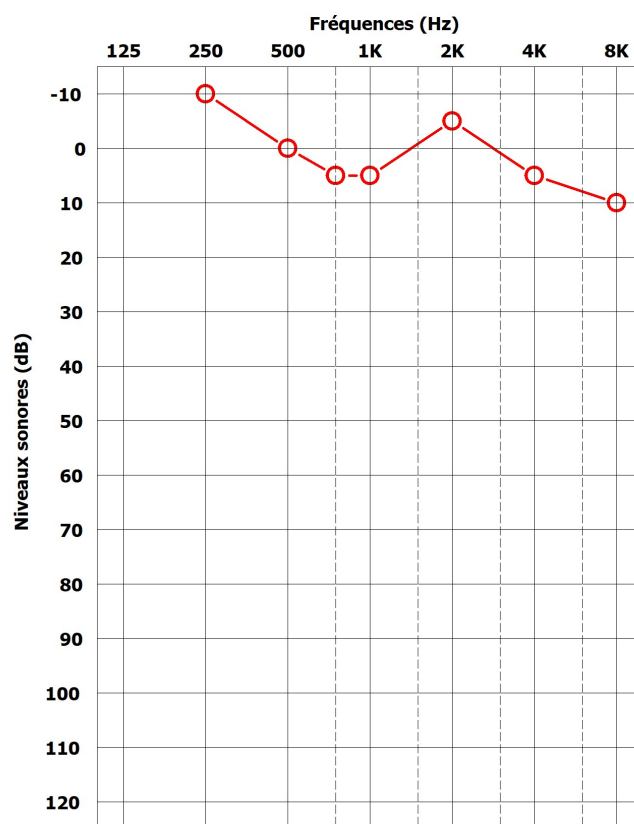

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	0	0	5		5		15		15
CA Droit		-10	0	5	5		-5		5		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	1,3 dB	---

Notes