

MEDVIE


Date du test: 02/06/2025 11:54:26

Durée: 7mn 37s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		FOFANA Morlaye
Date de naissance	12/04/1979	
Age	46	
Société	GPC	
ID	25060211522415322	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

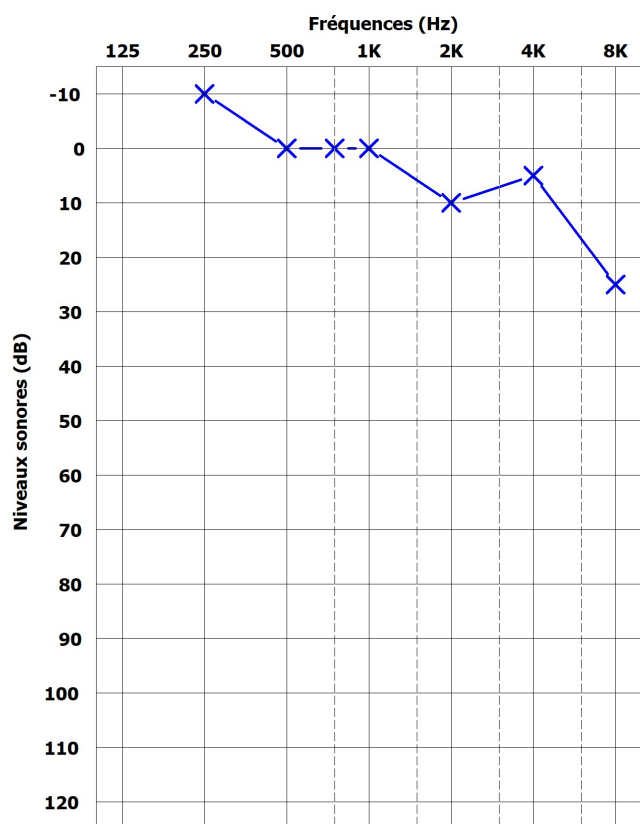

Oreille Gauche

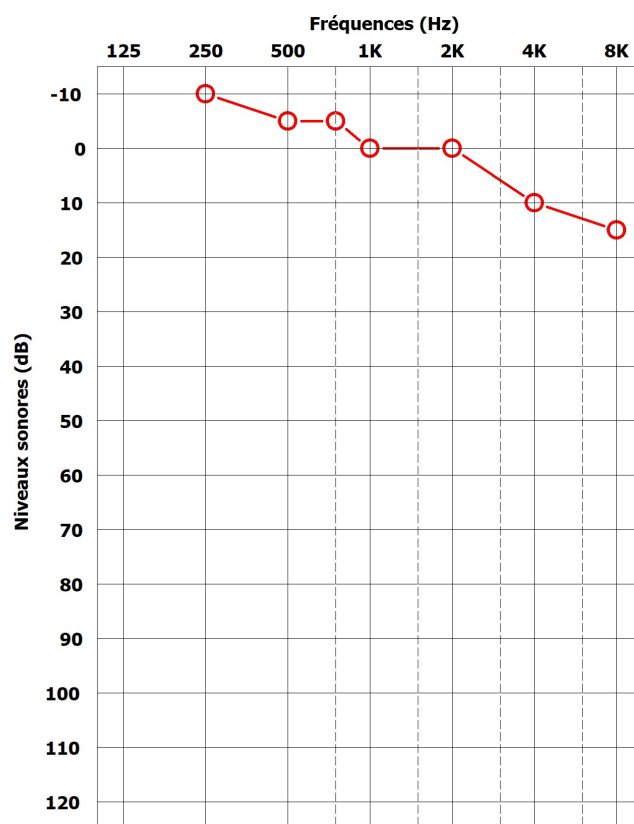

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-10	0	0	0		10		5		25
CA Droit		-10	-5	-5	0		0		10		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	3,8 dB	---
CA Droit	1,3 dB	---

Notes