


MEDVIE


Date du test: 15/06/2024 19:38:19

Durée: 4mn 08s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

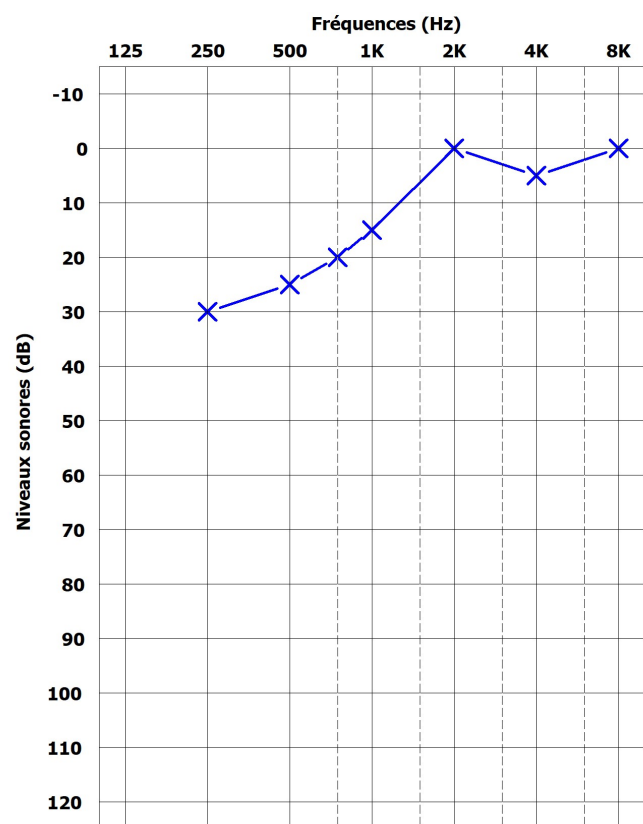

Oreille Gauche

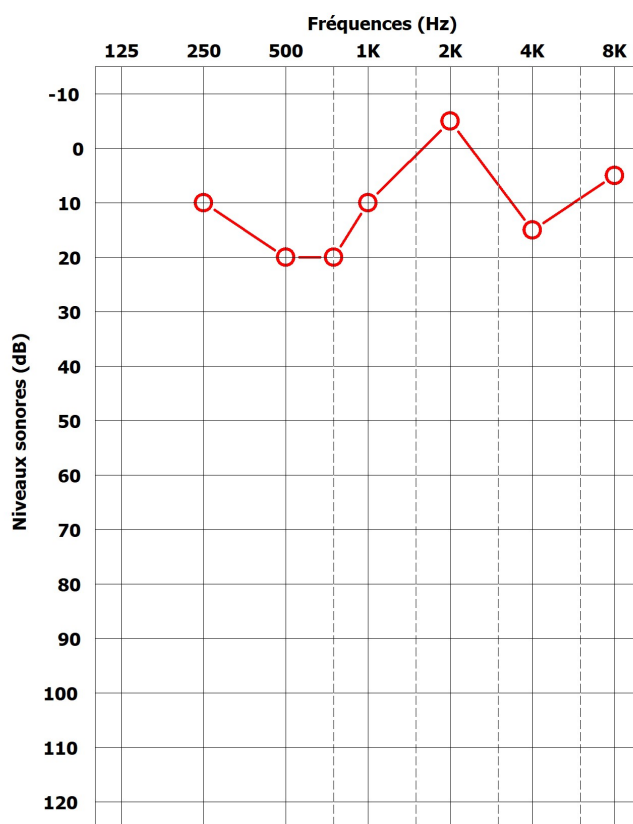

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	25	20	15		0		5		0
CA Droit		10	20	20	10		-5		15		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes

Données Patient	SYLLA ABOUBACAR
Date de naissance	21/07/1993
Age	30
Société	GPC
ID	24061519340514015

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021