


MEDVIE


Date du test: 28/04/2025 11:17:51
Durée: 2mn 58s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA FATOUMATA	
Date de naissance	09/09/1997
Age	27
Société	GPC
ID	25042811113775405

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

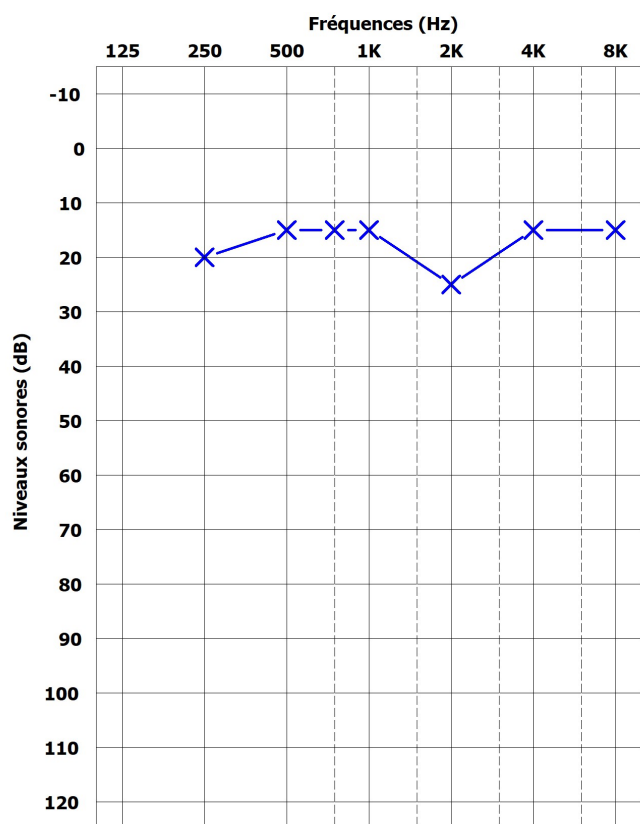

Oreille Gauche

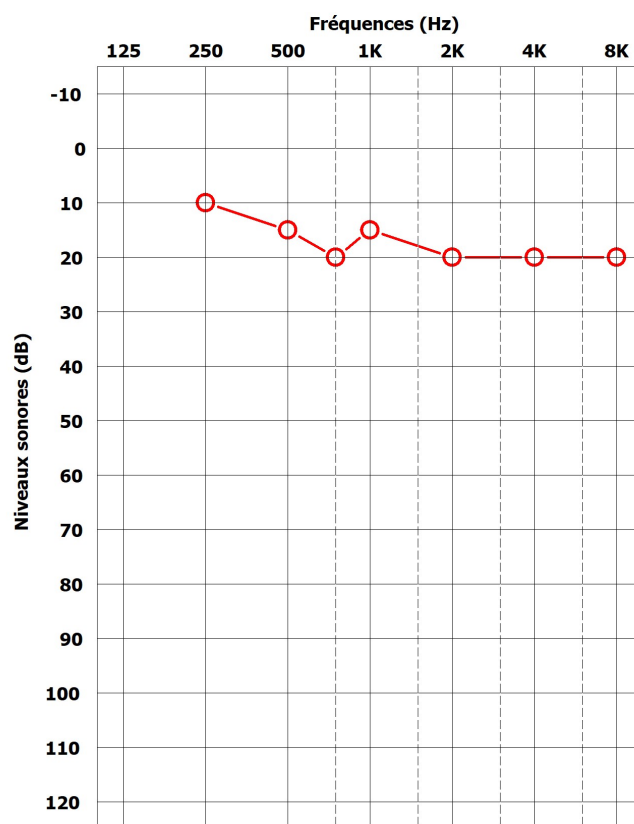

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	15	15	15		25		15		15
CA Droit		10	15	20	15		20		20		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes