

MEDVIE

Date du test: 28/02/2024 12:04:04

Durée: 8mn 04s

 Type test
 Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Données Patient

FOFONA LONCENY

Date de naissance 01/01/1992

Age 32

Société WELHY


ID 24022812015955187

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

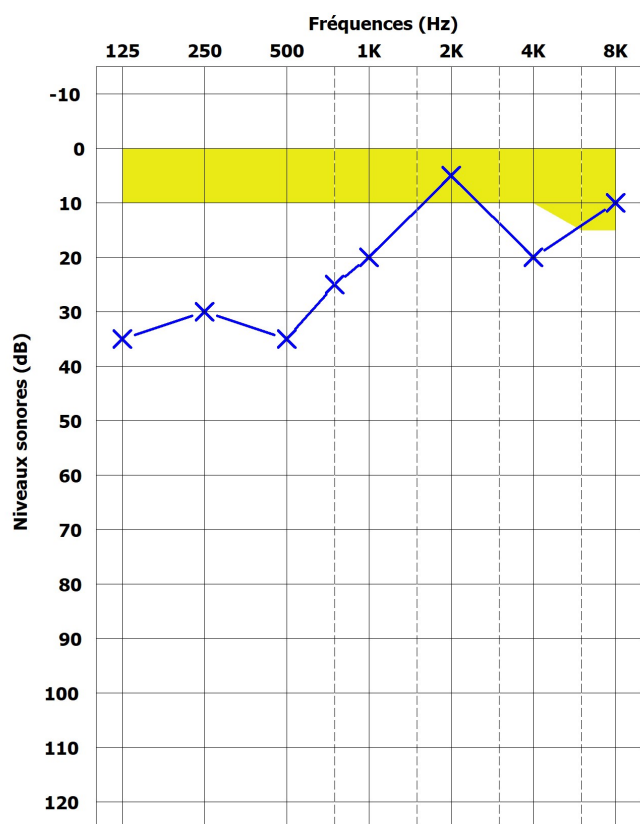

Oreille Gauche

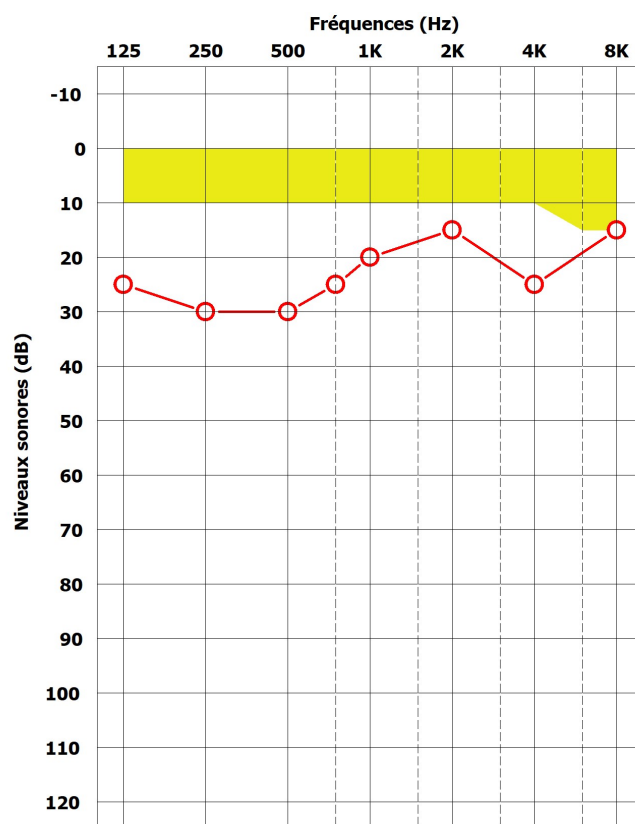

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	35	30	35	25	20		5		20		10
CA Droit	25	30	30	25	20		15		25		15

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	22,5 dB	---

Notes