



MEDVIE

Date du test: 23/07/2024 14:33:57
Durée: 4mn 54s
Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

CLEMENTS DAVID
RONAKO CLEMENTS

Date de naissance

01/02/1970

Age

54

Société

WELHY-CIS

ID

24072314302363973

Audiomètre

Type:


Audio 820M V2,211

Numéro de série:


2111EAT690092

Date Calibration :

30/11/2021

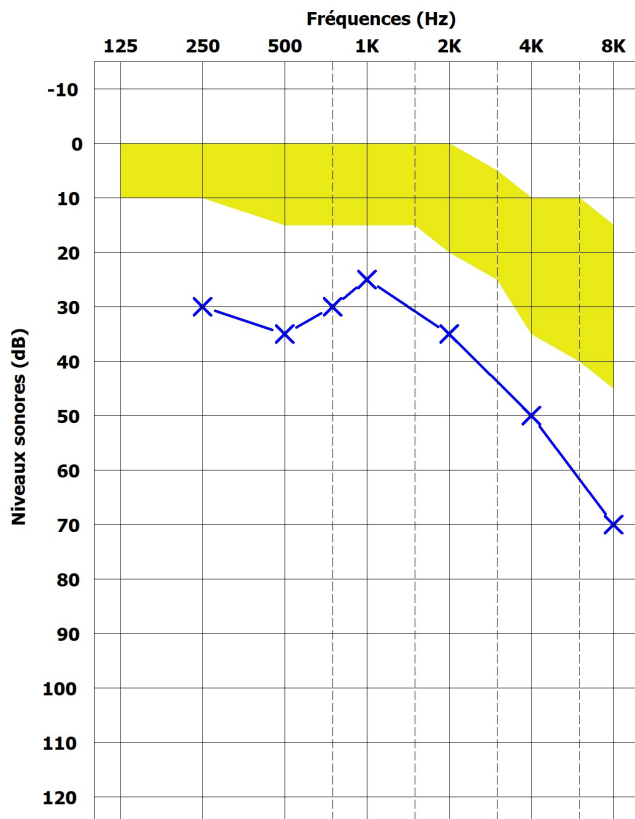

Oreille Gauche

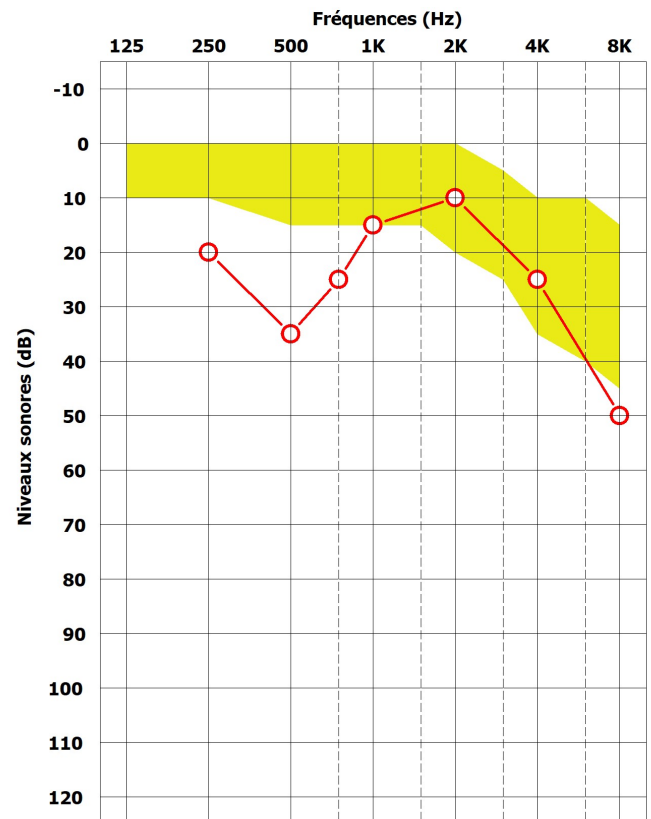

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	35	30	25		35		50		70
CA Droit		20	35	25	15		10		25		50

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	36,3 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes