


MEDVIE


Date du test: 28/02/2024 12:57:03

Durée: 5mn 45s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

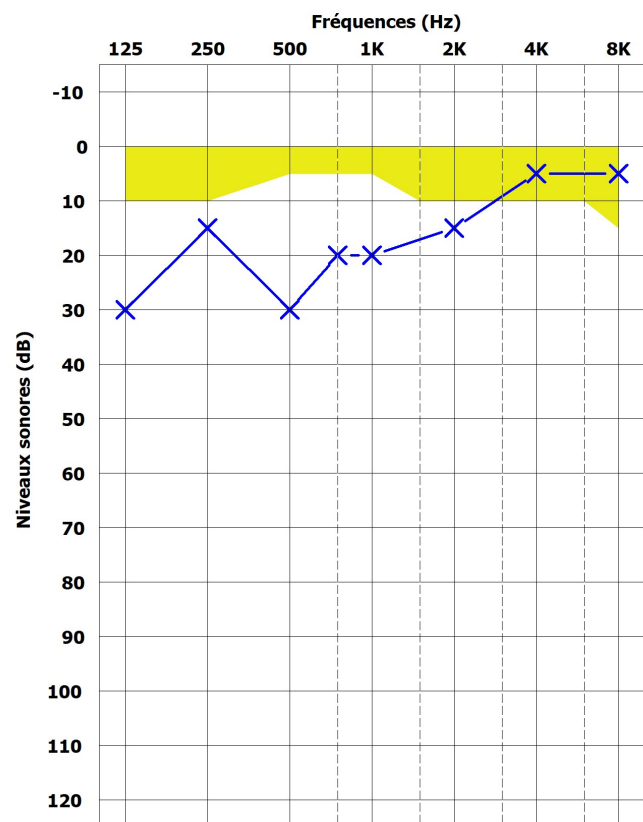

Oreille Gauche

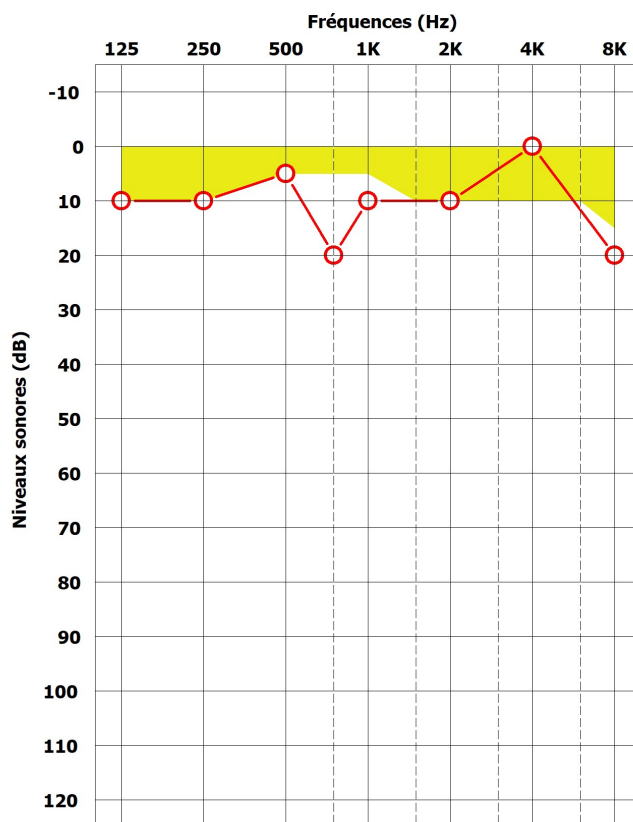

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	15	30	20	20		15		5		5
CA Droit	10	10	5	20	10		10		0		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes

Données Patient	CONDE SEKOU
Date de naissance	01/01/1994
Age	30
Société	WELHY
ID	24022812541210229

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021