

MEDVIE


Date du test: 20/05/2025 11:16:25

Durée: 4mn 31s


Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient   | MOONIER SYLVAIN<br>JACOUES |
|-------------------|----------------------------|
| Date de naissance | 06/09/1970                 |
| Age               | 54                         |
| Société           | WELHY                      |
| ID                | 25052011133205543          |

| Audiomètre                     |
|--------------------------------|
| Type: Audio 820M V2,211        |
| Numéro de série: 2111EAT690093 |
| Date Calibration : 30/11/2021  |

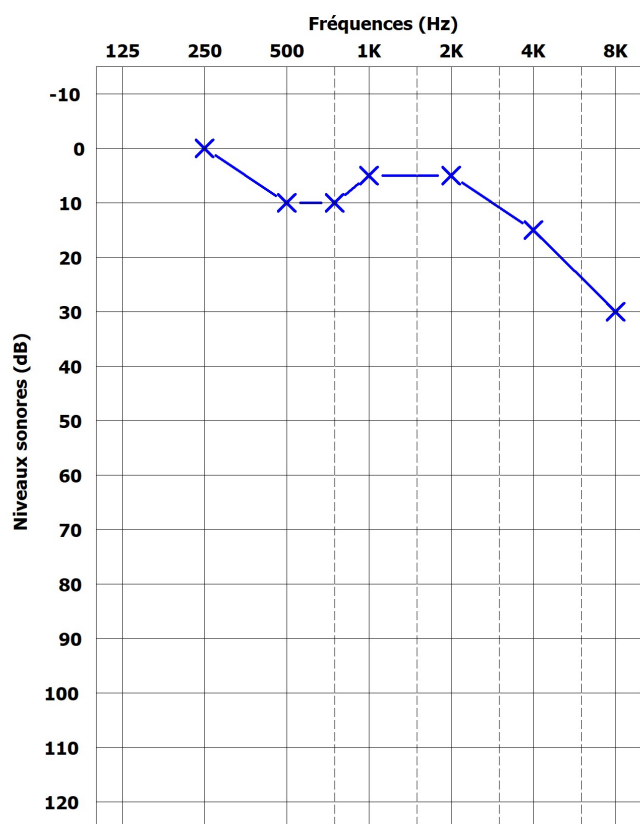

Oreille Gauche

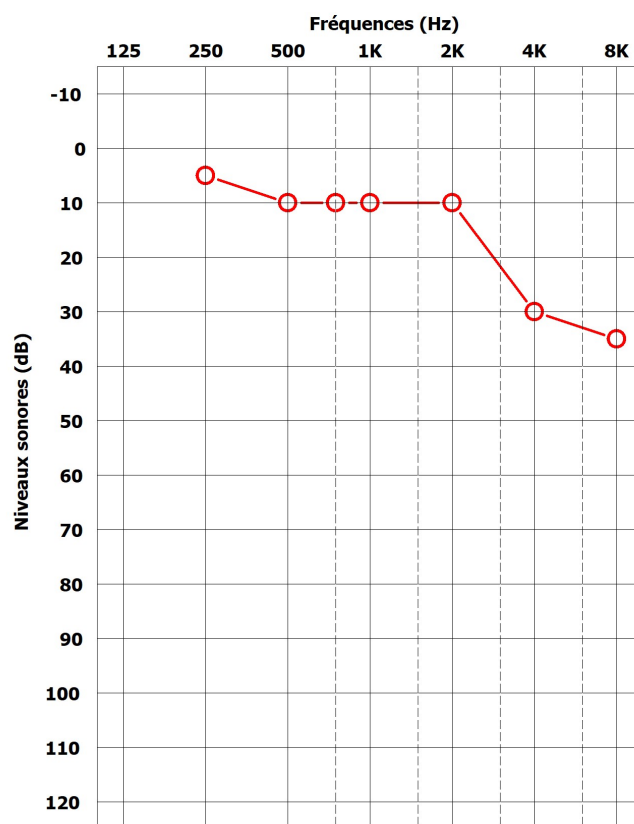

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 0   | 10  | 10  | 5  |     | 5  |    | 15 |    | 30 |
| CA Droit  |     | 5   | 10  | 10  | 10 |     | 10 |    | 30 |    | 35 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 8,8 dB  | --- |
| CA Droit        | 15,0 dB | --- |

Notes