


MEDVIE


Date du test: 28/02/2024 10:29:00
Durée: 10mn 26s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		SAGNO MOMO
Date de naissance	25/03/1995	
Age	28	
Société	WELHY	
ID	24022810271577489	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

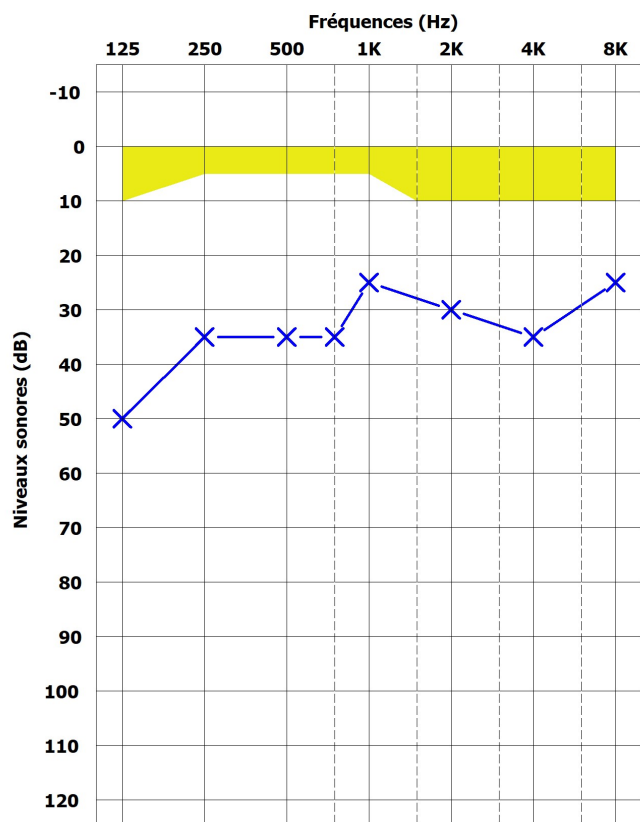

Oreille Gauche

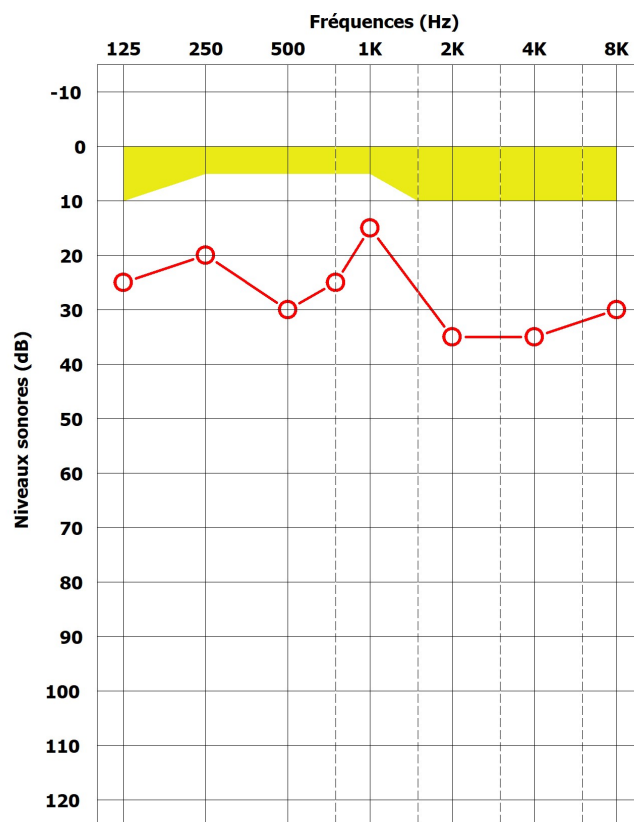

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	50	35	35	35	25		30		35		25
CA Droit	25	20	30	25	15		35		35		30

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	31,3 dB	---
CA Droit	28,8 dB	---

Notes