

MEDVIE


Date du test: 27/02/2024 11:28:58

Durée: 7mn 57s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
FOFANA MAKEME	
Date de naissance	25/01/1997
Age	27
Société	WELHY
ID	24022711235881447

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

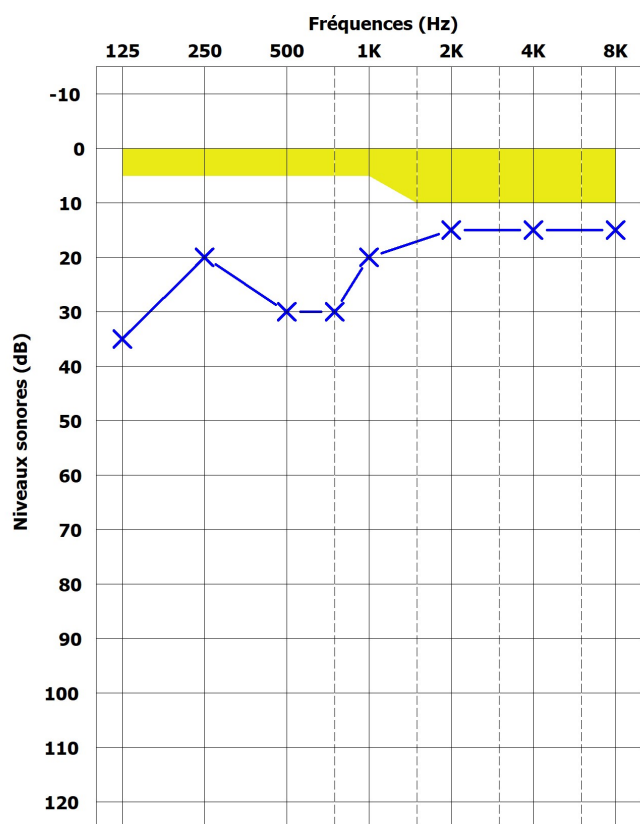

Oreille Gauche

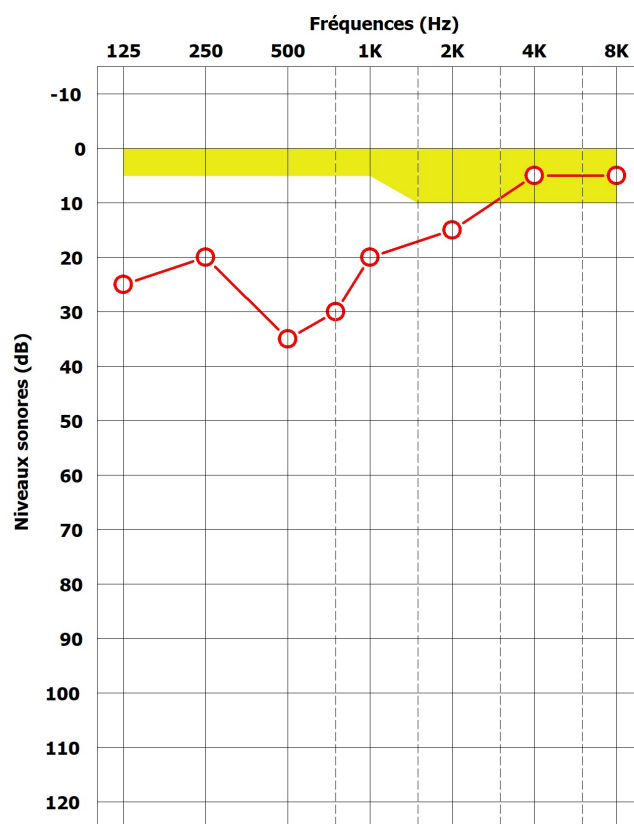

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	35	20	30	30	20		15		15		15
CA Droit	25	20	35	30	20		15		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes