



MEDVIE

Date du test: 14/07/2025 13:12:25
Durée: 5mn 01s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

MALCOLM STRACHAN

Date de naissance

28/01/1966

Age

59

Société

WELHY

ID

25071413081286280

Audiomètre

Type:


Audio 820M V2,211

Numéro de série:


2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021

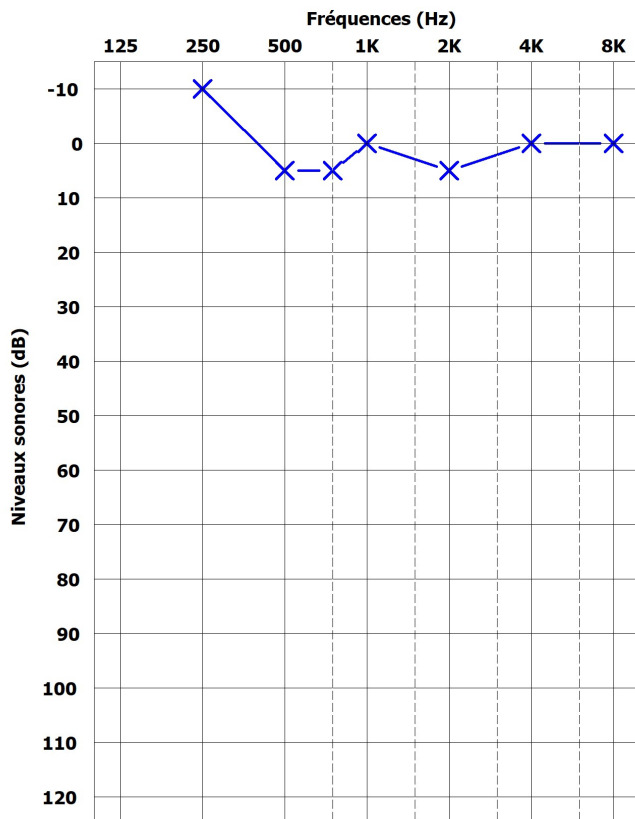

Oreille Gauche

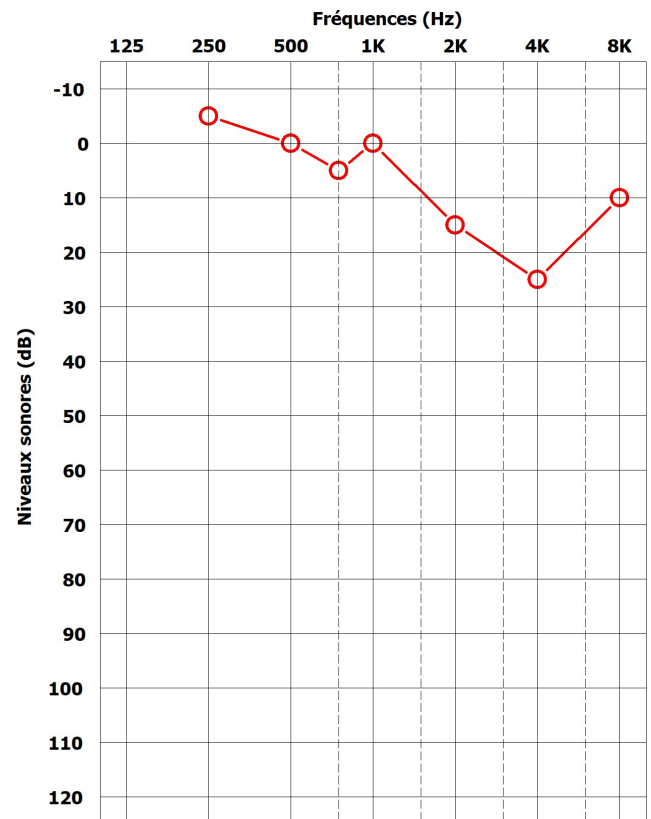

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-10	5	5	0		5		0		0
CA Droit		-5	0	5	0		15		25		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	2,5 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes