


MEDVIE


Date du test: 14/06/2025 14:01:15
Durée: 3mn 42s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
	CLEMENTS DAVID RONAN
Date de naissance	01/02/1970
Age	55
Société	WELHY
ID	25061413594651445

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

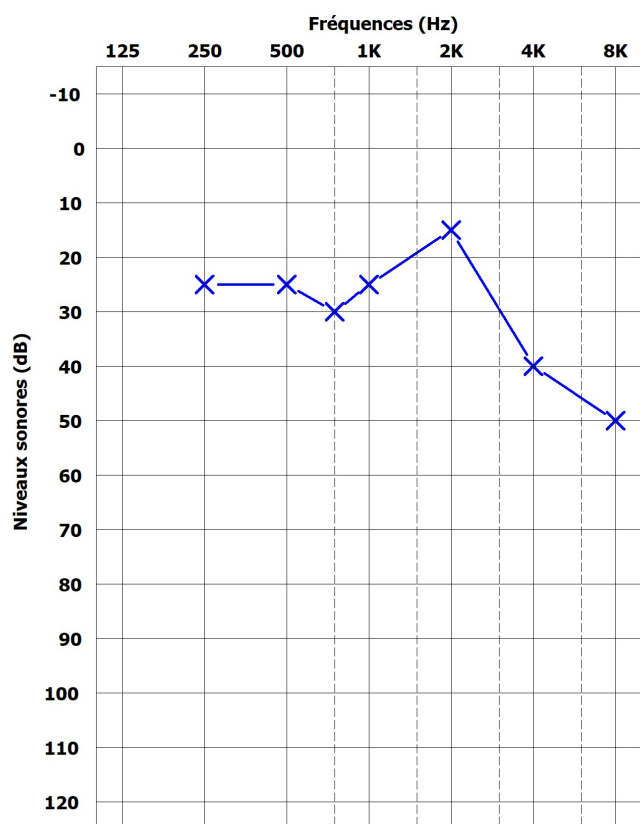

Oreille Gauche

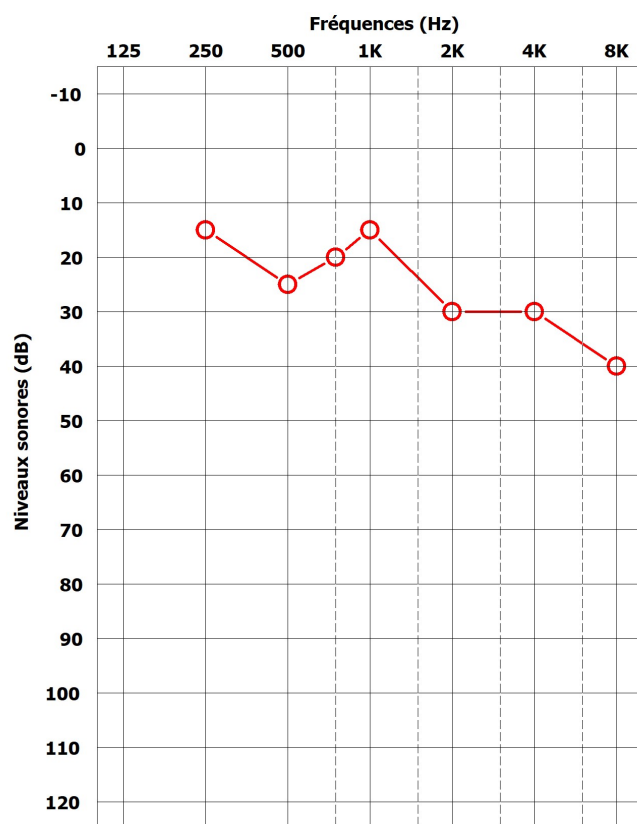

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	30	25		15		40		50
CA Droit		15	25	20	15		30		30		40

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	26,3 dB	---
CA Droit	25,0 dB	---

Notes