


MEDVIE


Date du test: 03/03/2025 13:55:13

Durée: 6mn 13s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

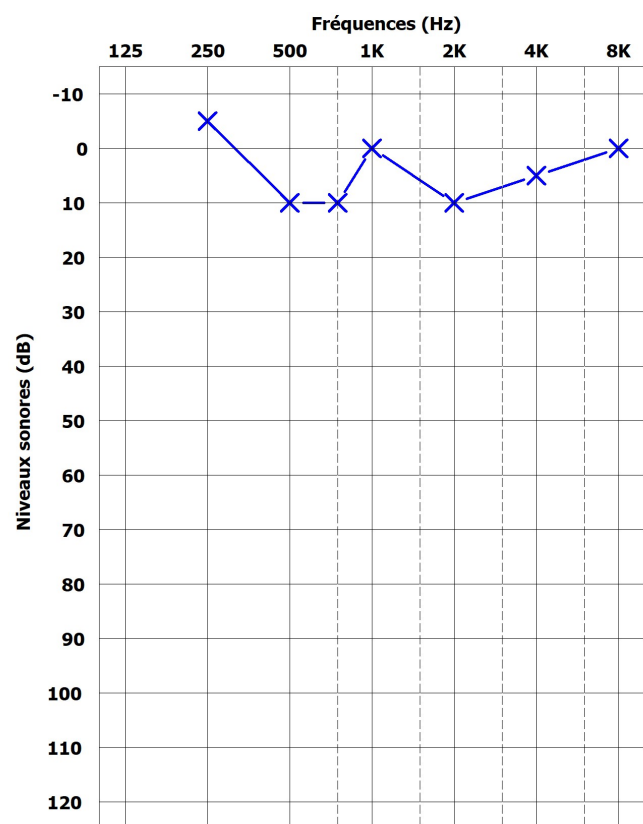

Oreille Gauche

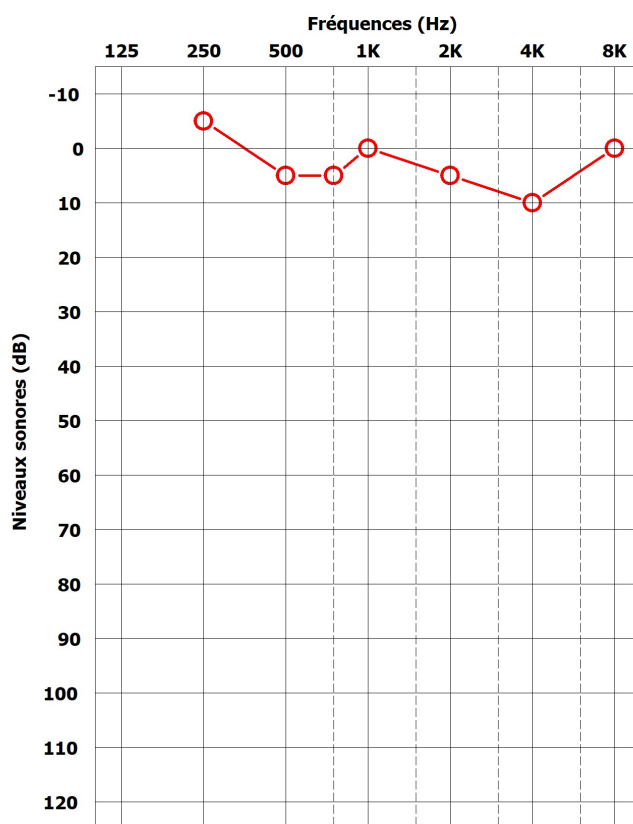

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	10	10	0		10		5		0
CA Droit		-5	5	5	0		5		10		0

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes

Données Patient	NANJATI ABDOU
Date de naissance	20/07/1991
Age	33
Société	WELHY CIS
ID	25030313514696606

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021