

MEDVIE


Date du test: 04/06/2024 13:27:37

Durée: 3mn 37s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DIA SAIDOU FAREL	
Date de naissance	10/04/1978
Age	46
Société	WELHY
ID	24060413252077912

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

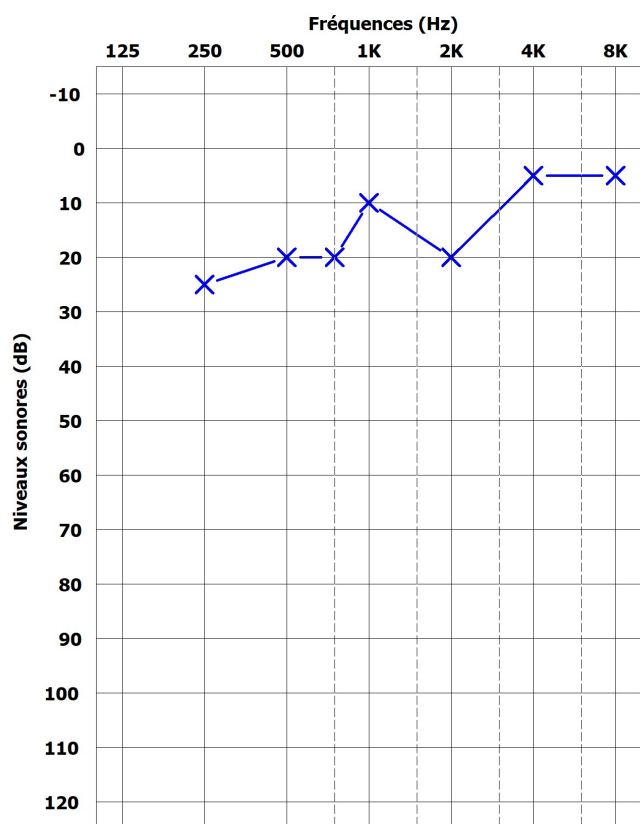

Oreille Gauche

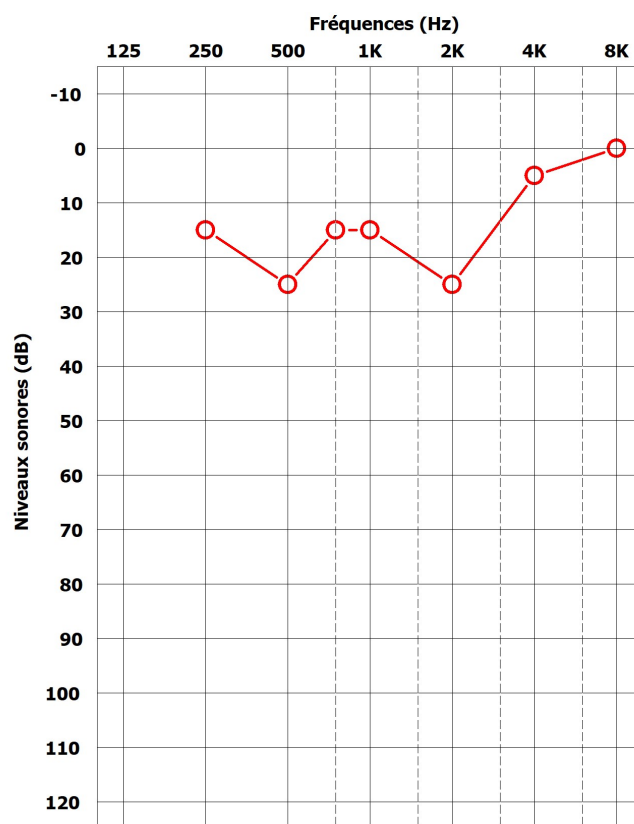

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	20	20	10		20		5		5
CA Droit		15	25	15	15		25		5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes