

MEDVIE

Date du test: 27/02/2024 09:16:53

Durée: 6mn 27s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

DIABATE FANTA

Date de naissance 01/01/1998

Age 26

Société WELHY


ID 24022709121144596

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

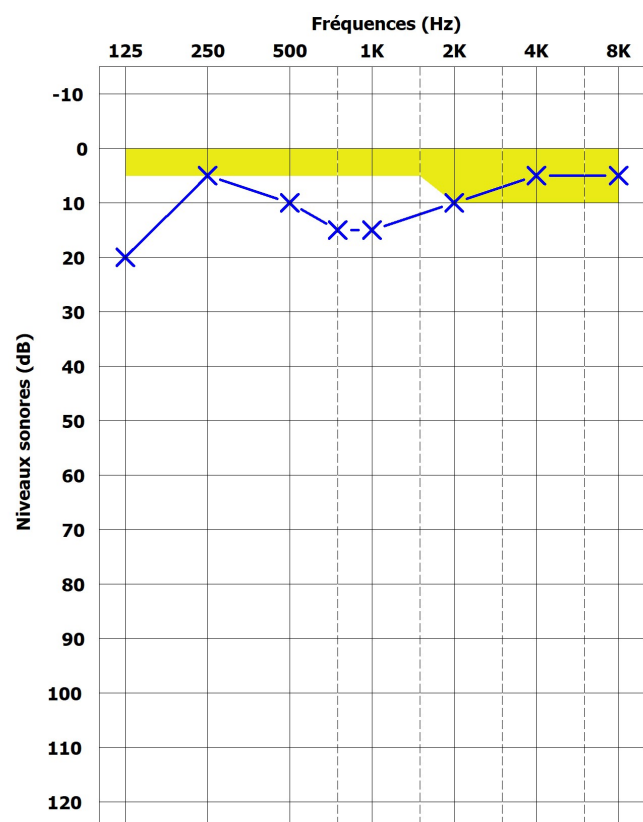

Oreille Gauche

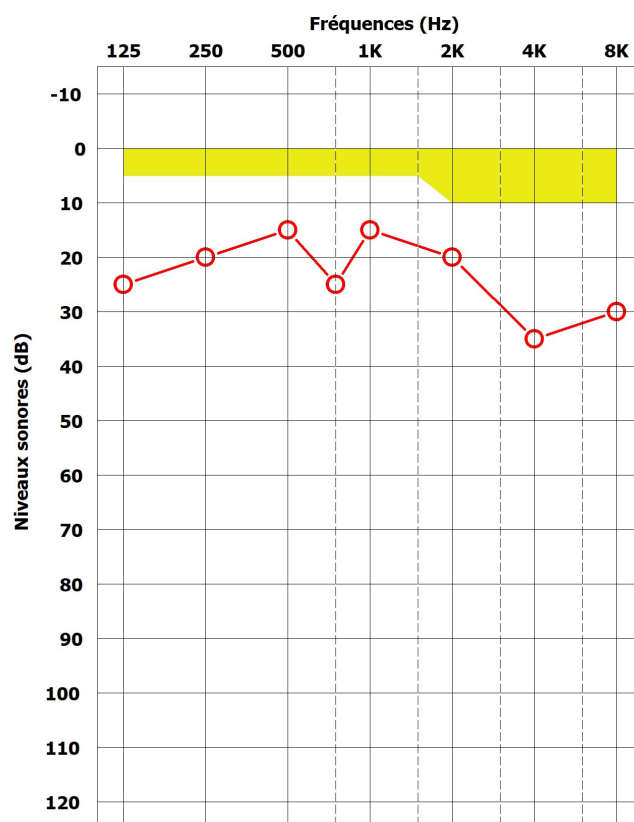

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	5	10	15	15		10		5		5
CA Droit	25	20	15	25	15		20		35		30

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes