


MEDVIE


Date du test: 27/02/2024 09:32:07

Durée: 2mn 57s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

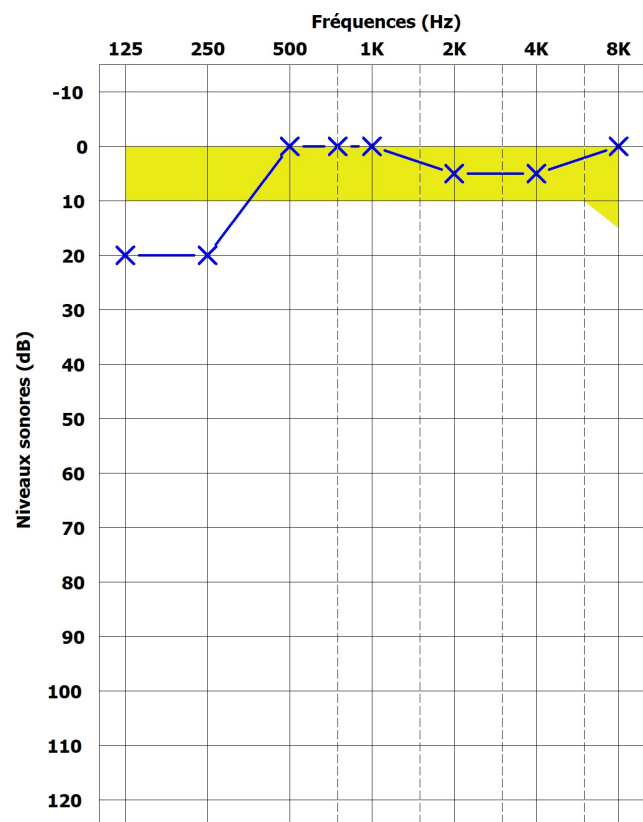

Oreille Gauche

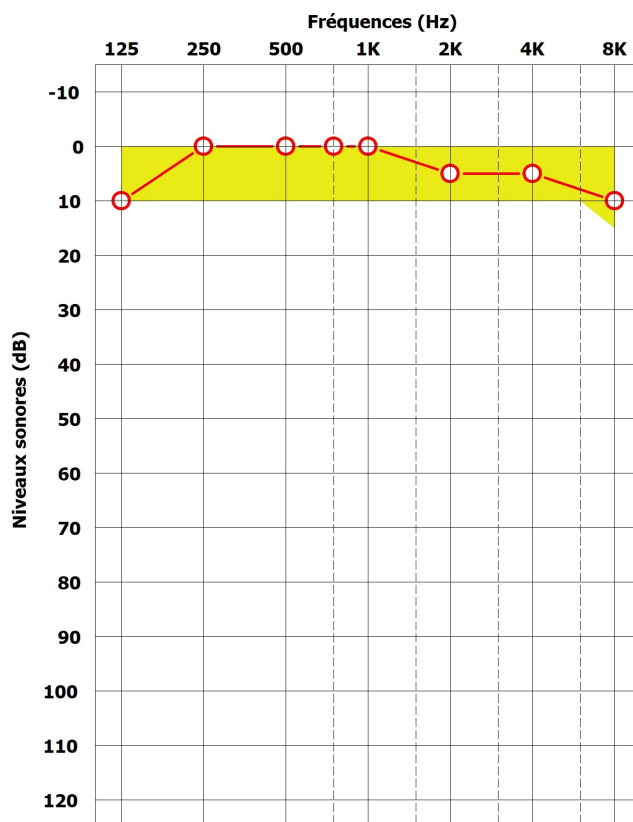

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	20	0	0	0		5		5		0
CA Droit	10	0	0	0	0		5		5		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	2,5 dB	---
CA Droit	2,5 dB	---

Notes

Données Patient

DOZON BINTOU

Date de naissance 25/11/1990

Age 33

Société WELHY

ID 24022709281928292

Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021