

MEDVIE

Date du test: 23/08/2025 12:13:03

Durée: 4mn 22s

Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

Données Patient

**HONGWEI YANG**

Date de naissance

30/01/1988

Age

37

Société

WELHY

ID

25082312055578123

Audiomètre

Type:


Audio 820M V2,211

Numéro de série:


2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021

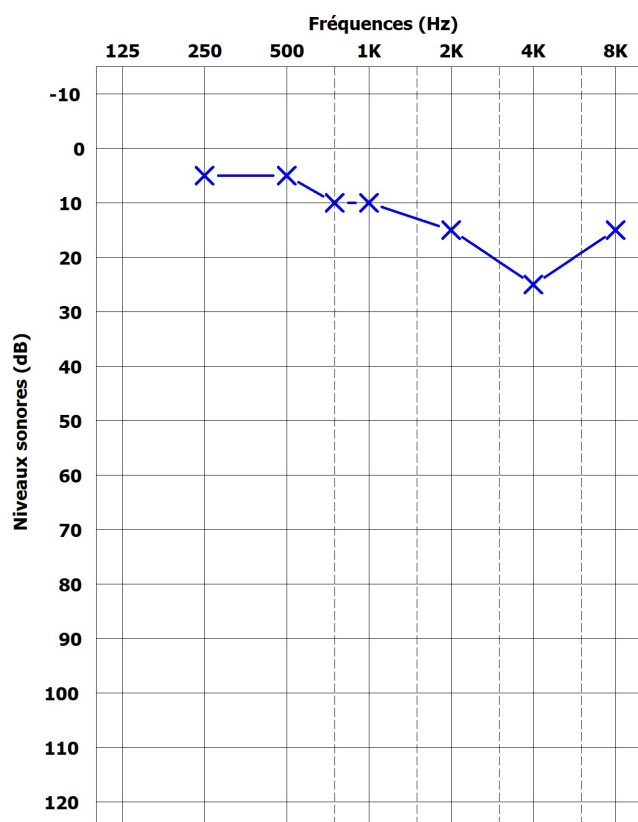

Oreille Gauche

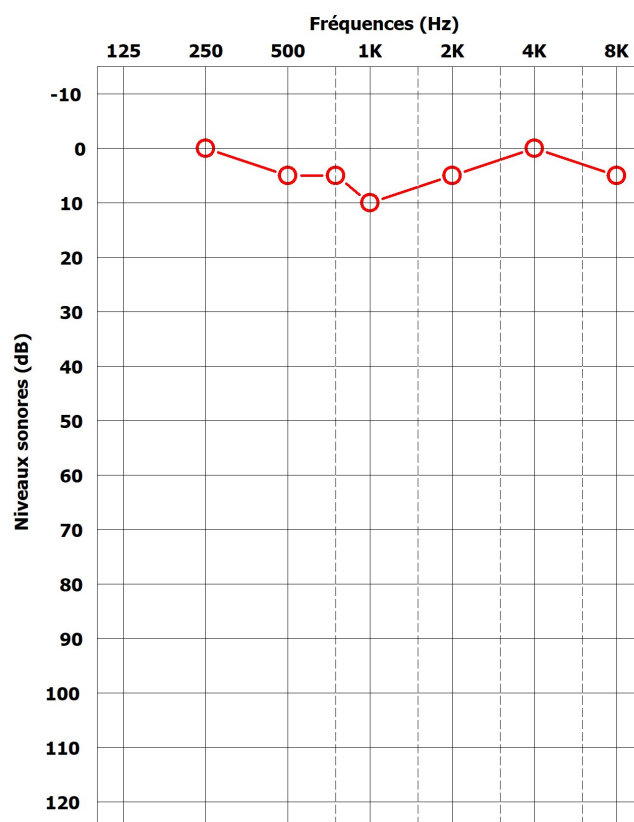

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 5   | 5   | 10  | 10 |     | 15 |    | 25 |    | 15 |
| CA Droit  |     | 0   | 5   | 5   | 10 |     | 5  |    | 0  |    | 5  |

Calcul de perte

|           | PAM     | IPA |
|-----------|---------|-----|
| CA Gauche | 13,8 dB | --- |
| CA Droit  | 5,0 dB  | --- |

Notes