



Données Patient		DOUBOUYA SEKOU
Date de naissance	01/01/1993	
Age	32	
Société	CR18	
ID	25031510434940850	

Date du test: 15/03/2025 10:46:08
 Durée: 4mn 39s
 Type test: Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

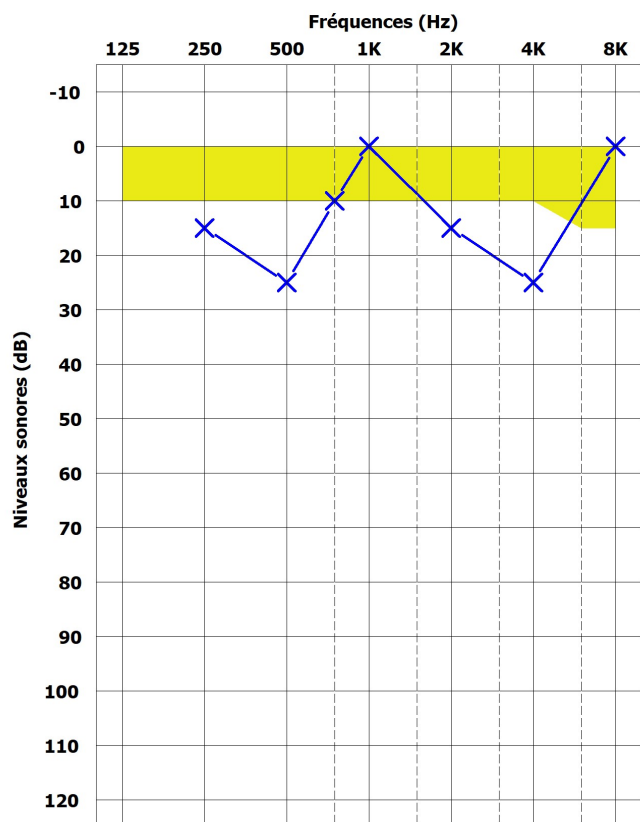

Oreille Gauche

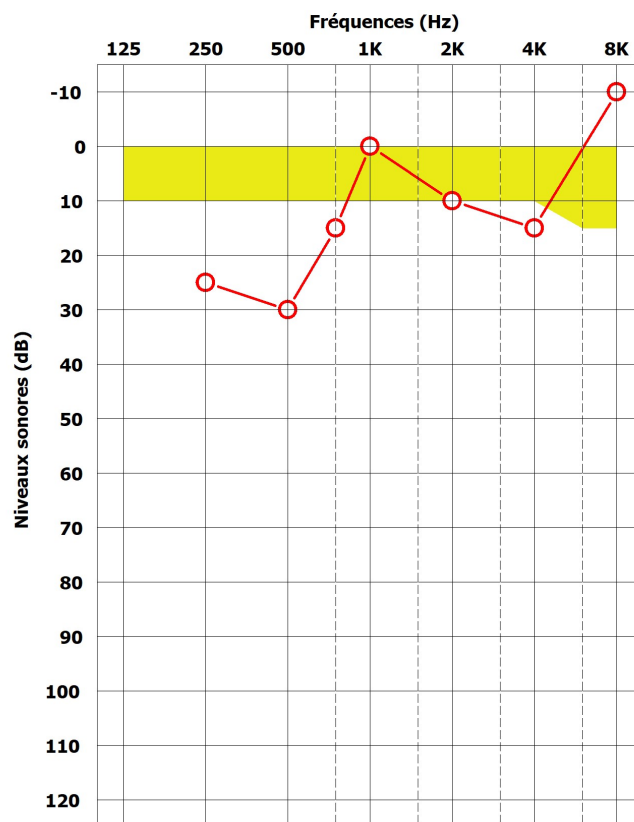

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	25	10	0		15		25		0
CA Droit		25	30	15	0		10		15		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes