


MEDVIE


Date du test: 02/07/2025 13:21:55
Durée: 4mn 04s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	TRAORE MAMADY
Date de naissance	13/07/1995
Age	29
Société	CR18
ID	25070213190962347

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

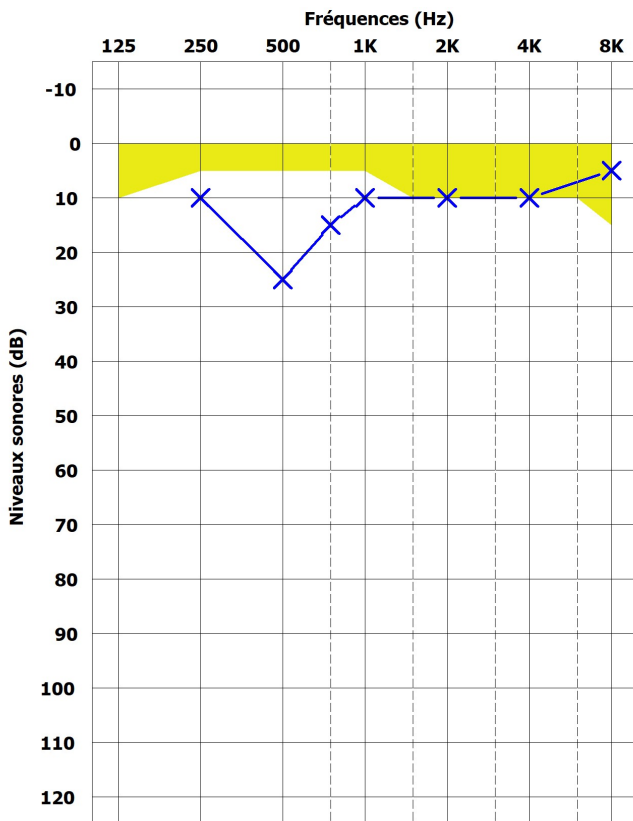

Oreille Gauche

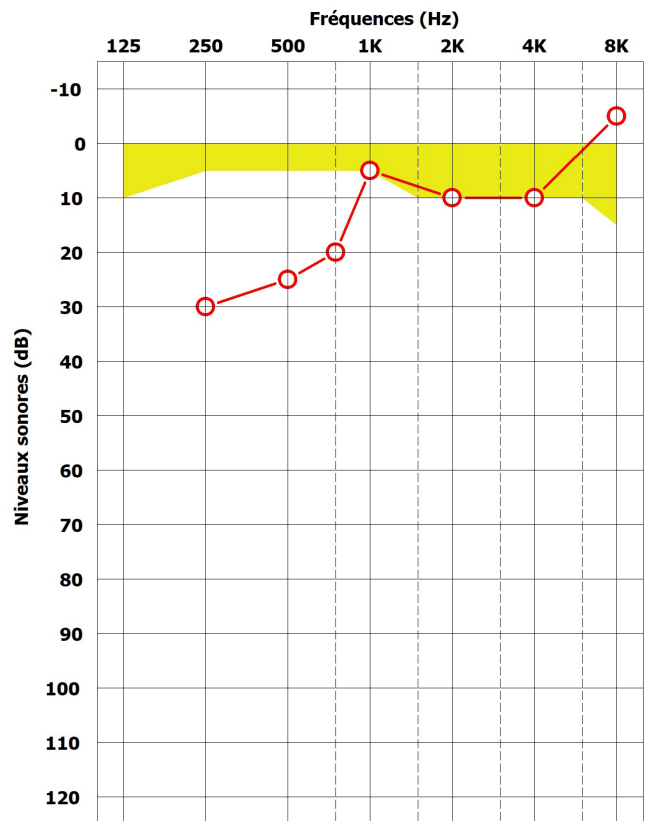

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	25	15	10		10		10		5
CA Droit		30	25	20	5		10		10		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes