

MEDVIE


Date du test: 14/03/2025 13:05:09

Durée: 5mn 47s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CAMARA GBE
Date de naissance	13/09/1997
Age	27
Société	CR18
ID	25031412250534184

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

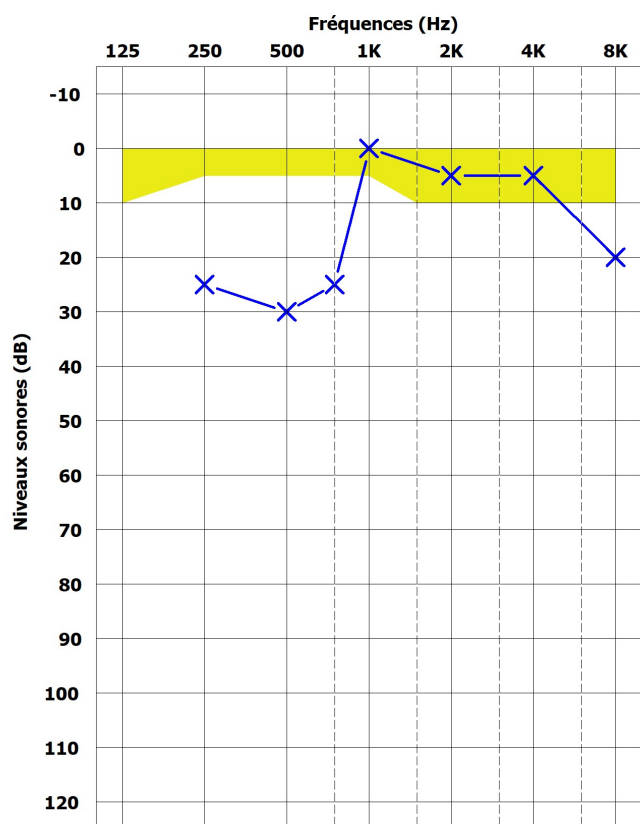

Oreille Gauche

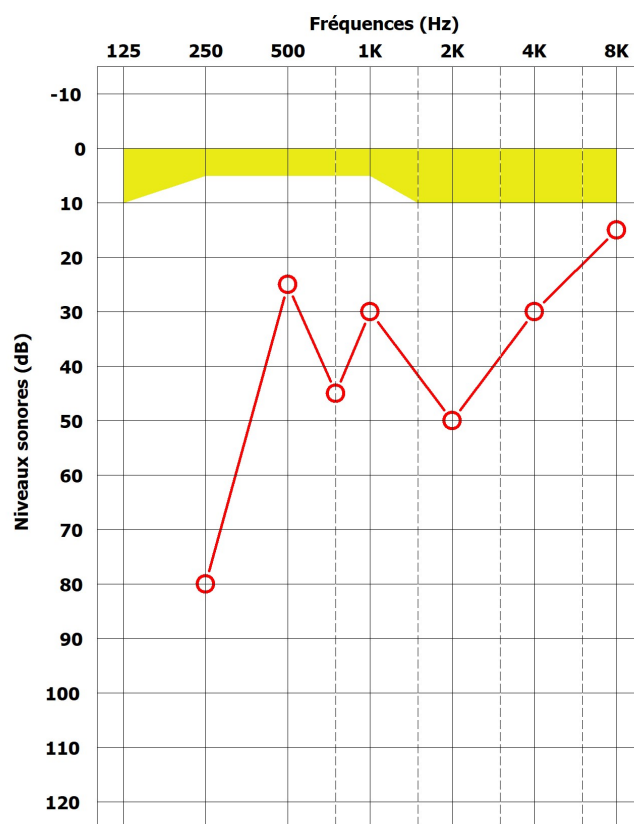

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	25	0		5		5		20
CA Droit		80	25	45	30		50		30		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	33,8 dB	---

Notes