

MEDVIE BEYLA

Date du test: 12/12/2024 15:05:09

Durée: 4mn 18s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

KABA KONATE

Date de naissance

01/01/2000

Age

24

Société

CR18

ID

24121214582337396

Audiomètre

Type:


Audio 820M V2,211

Numéro de série:


2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021

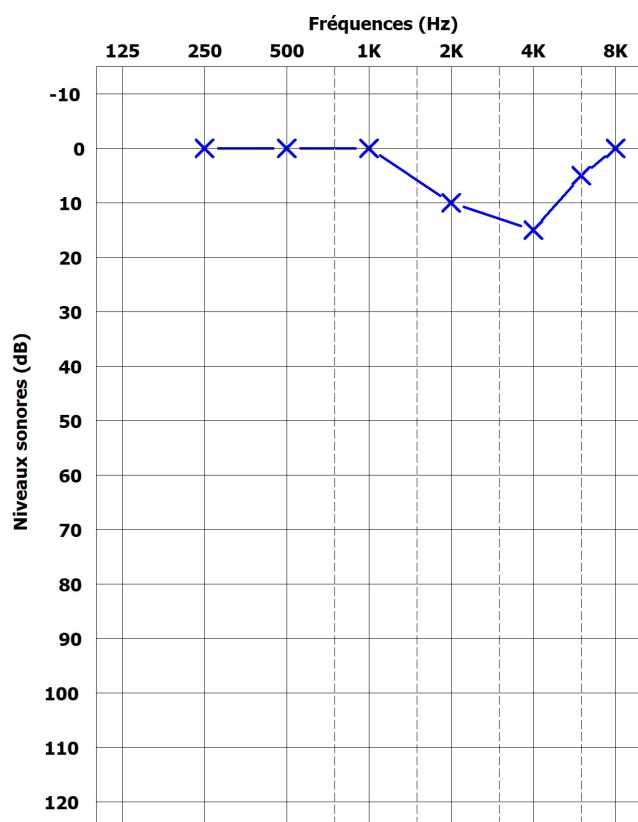

Oreille Gauche

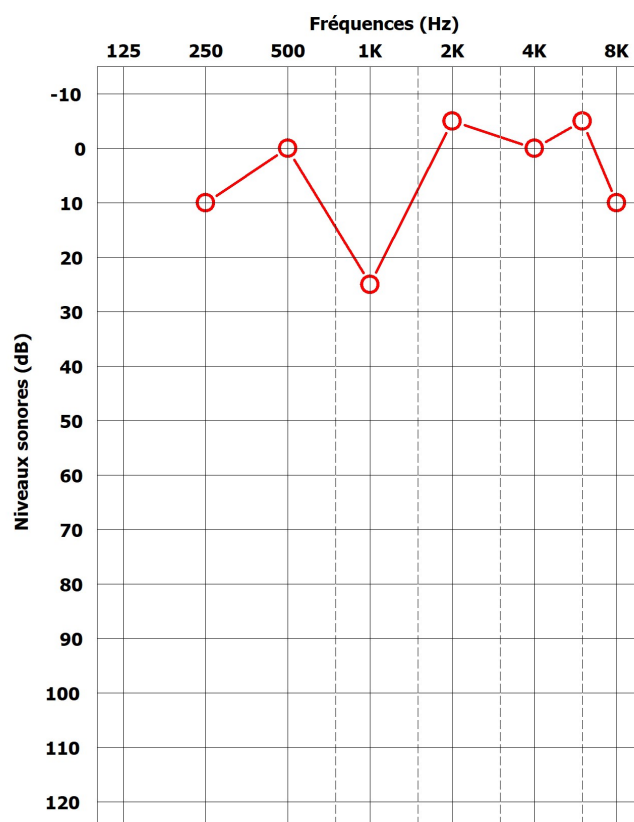

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	0		0		10		15	5	0
CA Droit		10	0		25		-5		0	-5	10

Calcul de perte

	PAM	
CA Gauche	---	0,0 dB
CA Droit	---	25,0 dB

Notes