


MEDVIE


Date du test: 01/05/2024 21:07:35

Durée: 8mn 26s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

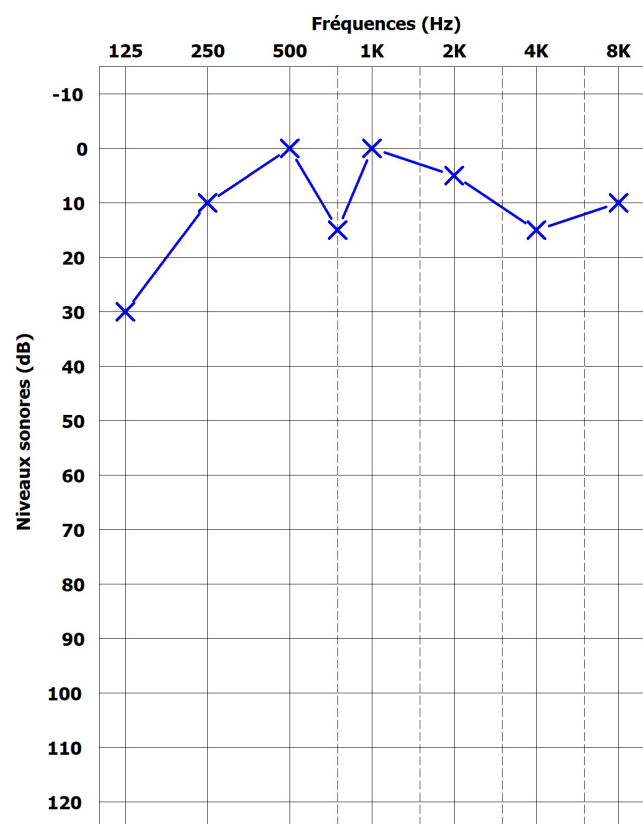

Oreille Gauche

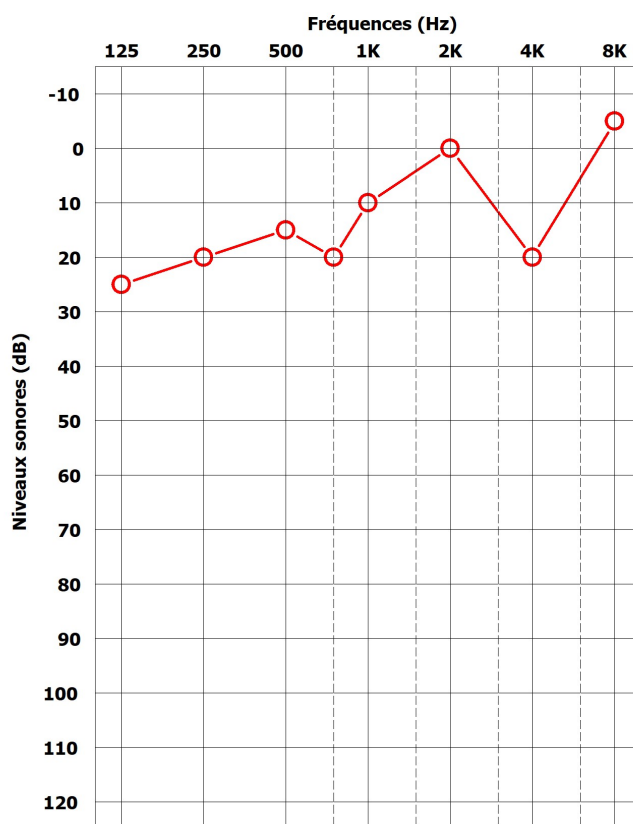

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	10	0	15	0		5		15		10
CA Droit	25	20	15	20	10		0		20		-5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes

Données Patient	CAMARA BANGALY
Date de naissance	01/01/1998
Age	26
Société	CR18
ID	24050121044469849

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021