



| Données Patient   |                   | CONDE SEYDOU |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Date de naissance | 01/01/1995        |              |
| Age               | 29                |              |
| Société           | CR18              |              |
| ID                | 24051711461264821 |              |

Date du test: 17/05/2024 11:51:12  
 Durée: -- mn -- s  
 Type test Manuel  
 Continu

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690093     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

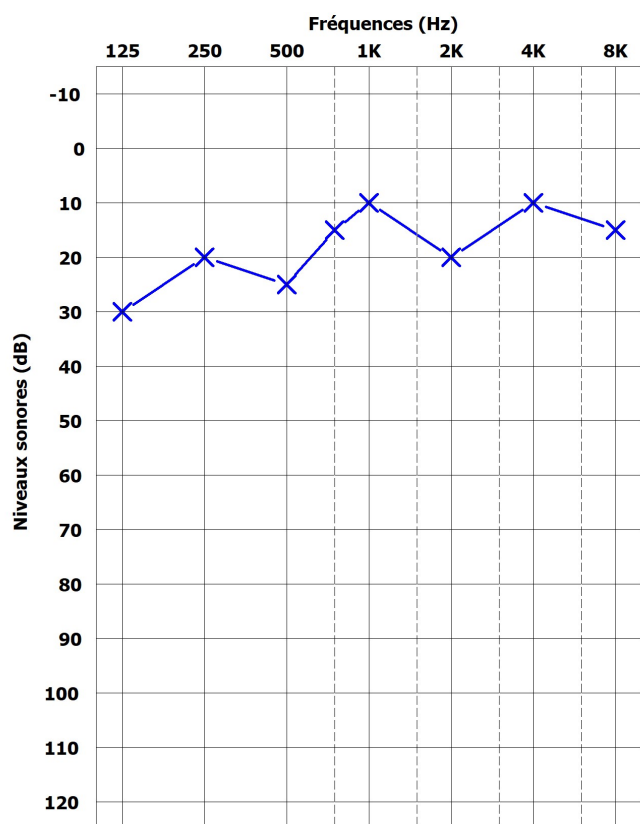

Oreille Gauche

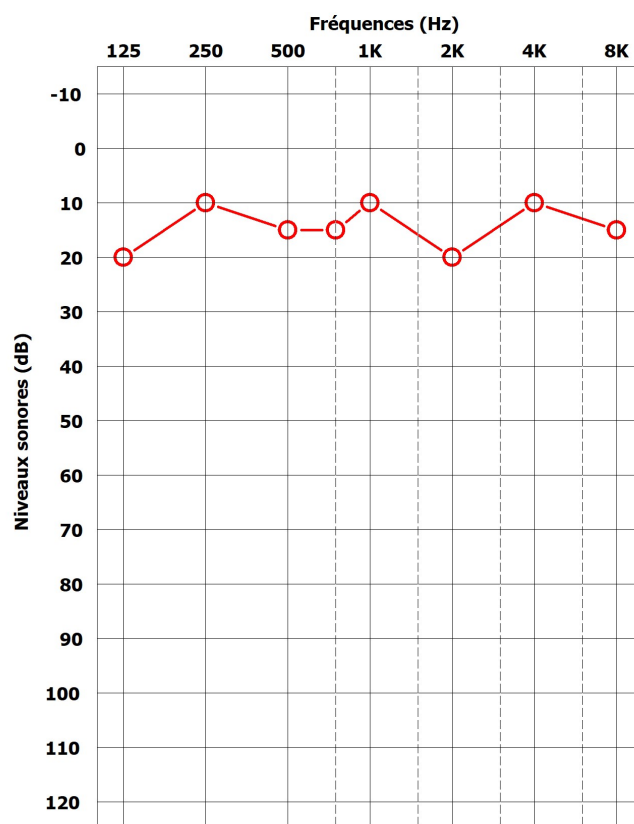

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche | 30  | 20  | 25  | 15  | 10 |     | 20 |    | 10 |    | 15 |
| CA Droit  | 20  | 10  | 15  | 15  | 10 |     | 20 |    | 10 |    | 15 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 16,3 dB | --- |
| CA Droit        | 13,8 dB | --- |

Notes