


MEDVIE


Date du test: 14/04/2025 13:02:02
Durée: 4mn 19s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		GUO KUIDE
Date de naissance		12/09/1971
Age		53
Société		CR18
ID		25041412575081522

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

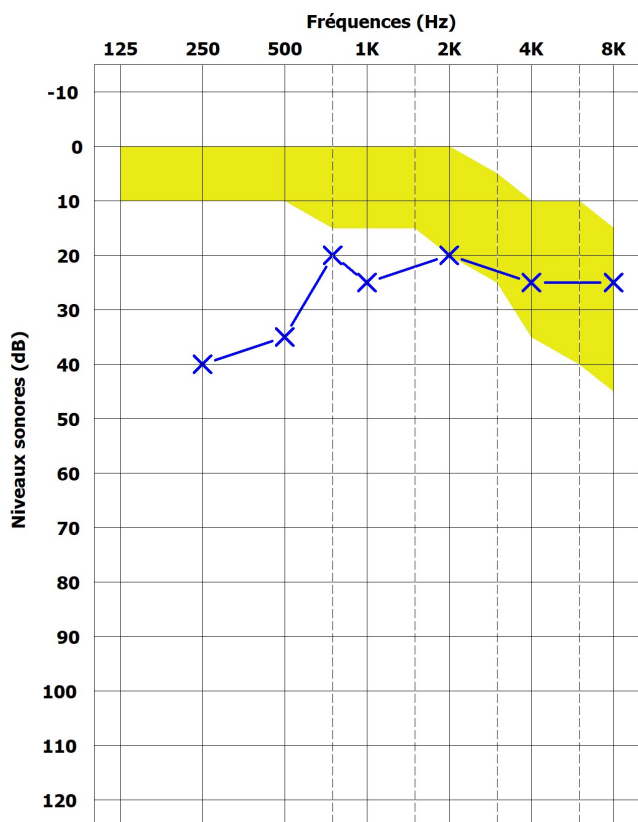

Oreille Gauche

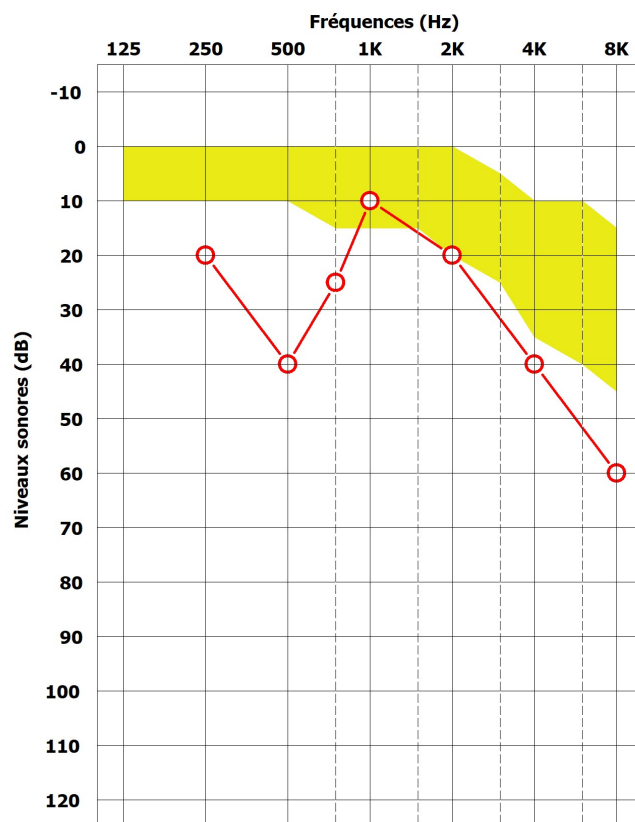

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		40	35	20	25		20		25		25
CA Droit		20	40	25	10		20		40		60

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	26,3 dB	---
CA Droit	27,5 dB	---

Notes