


MEDVIE


Date du test: 13/03/2025 12:29:54
Durée: 4mn 36s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	TRAORE Ibrahima
Date de naissance	01/01/1999
Age	26
Société	CR18
ID	25031312281725492

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

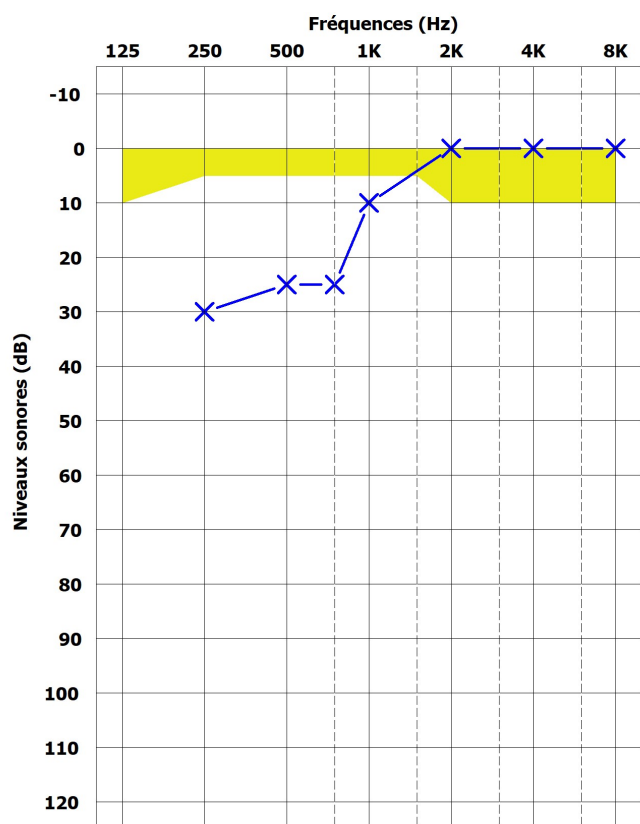

Oreille Gauche

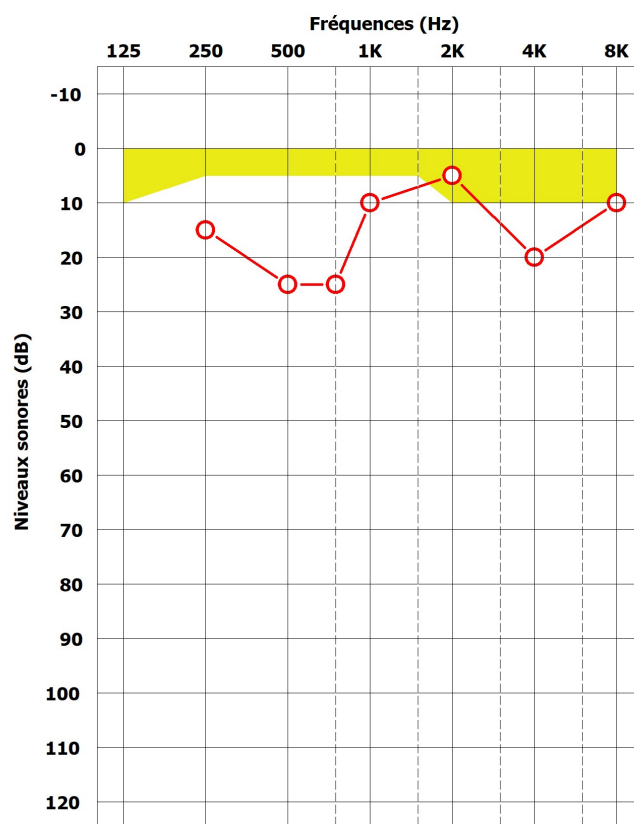

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	25	25	10		0		0		0
CA Droit		15	25	25	10		5		20		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes