


MEDVIE


Date du test: 05/03/2025 17:35:07
Durée: 5mn 03s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	TRAORE OUSMANE
Date de naissance	01/07/1973
Age	51
Société	CR18
ID	25030515084359754

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

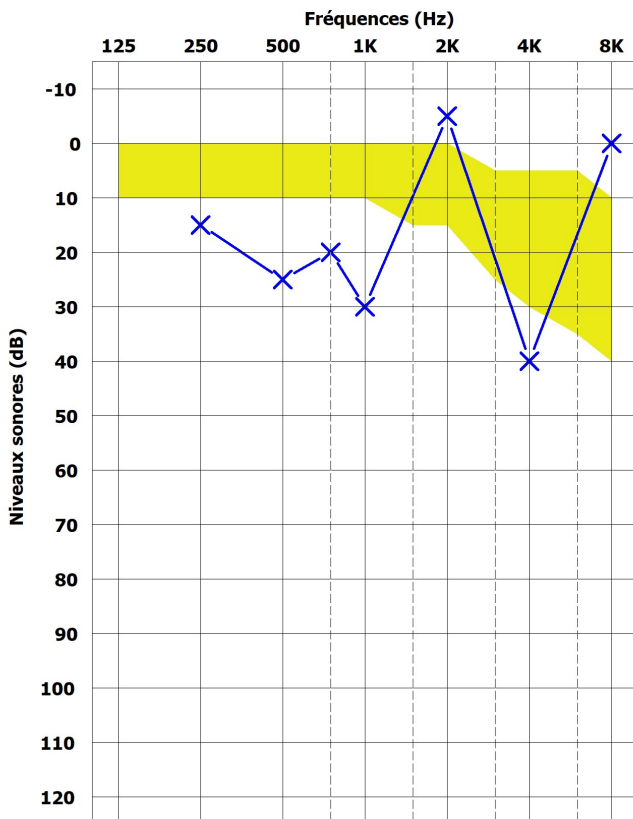

Oreille Gauche

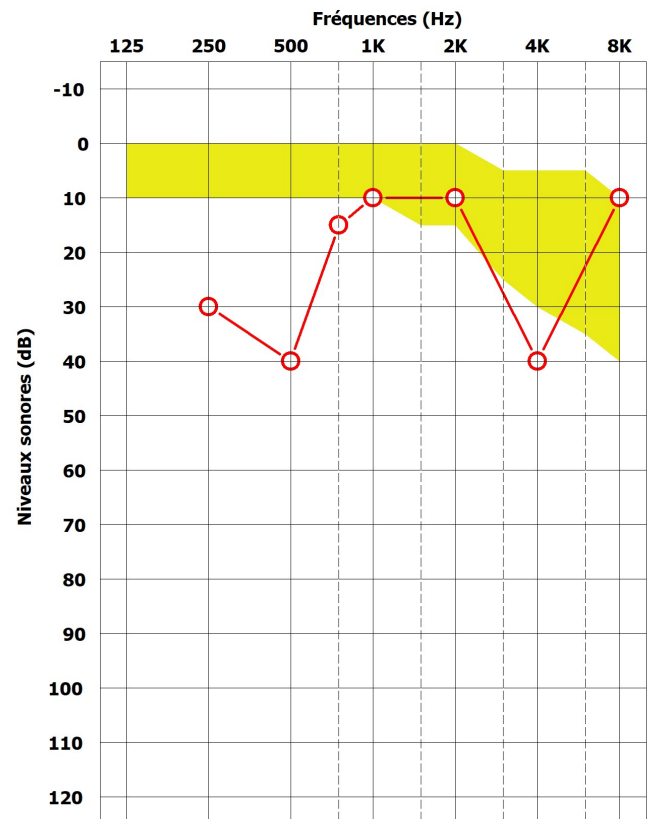

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	25	20	30		-5		40		0
CA Droit		30	40	15	10		10		40		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	25,0 dB	---

Notes