



Données Patient		CHANG YUELIANG
Date de naissance	29/04/1988	
Age	36	
Société	CR18	
ID	24050418590457848	

Date du test: 04/05/2024 19:12:09
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

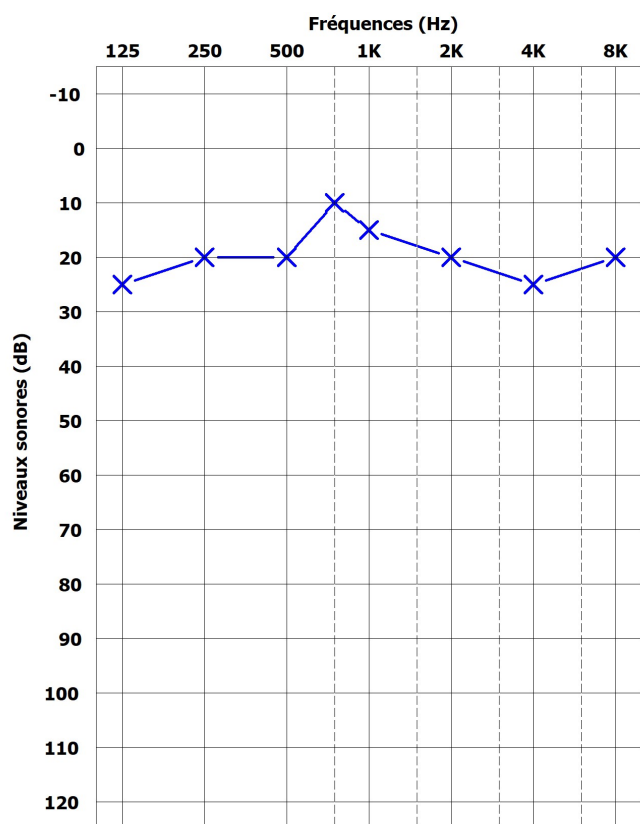

Oreille Gauche

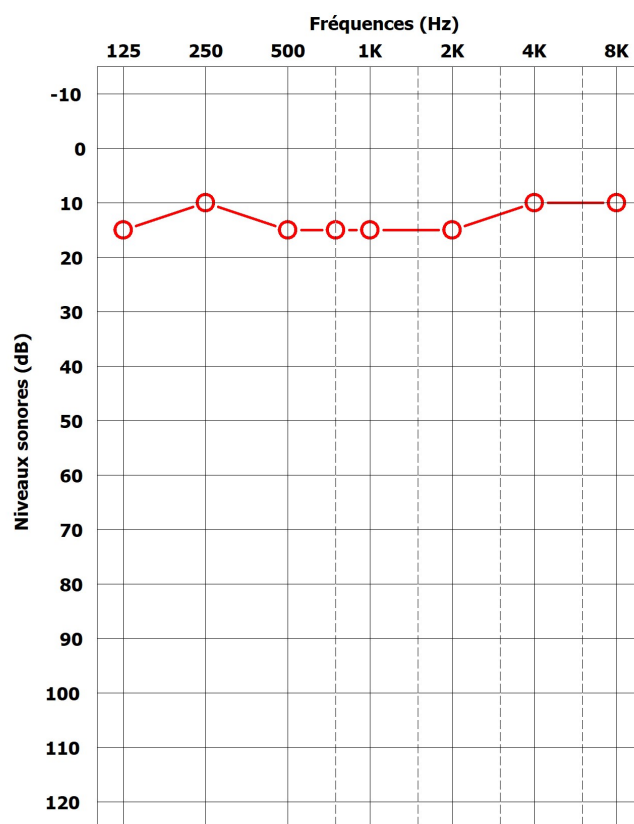

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	20	20	10	15		20		25		20
CA Droit	15	10	15	15	15		15		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes