


MEDVIE


Date du test: 24/05/2024 14:05:35
 Durée: -- mn -- s
 Type test Manuel
 Continu

Données Patient	TRAORE N'FALY
Date de naissance	01/01/2001
Age	23
Société	CR18
ID	24052414021598412

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

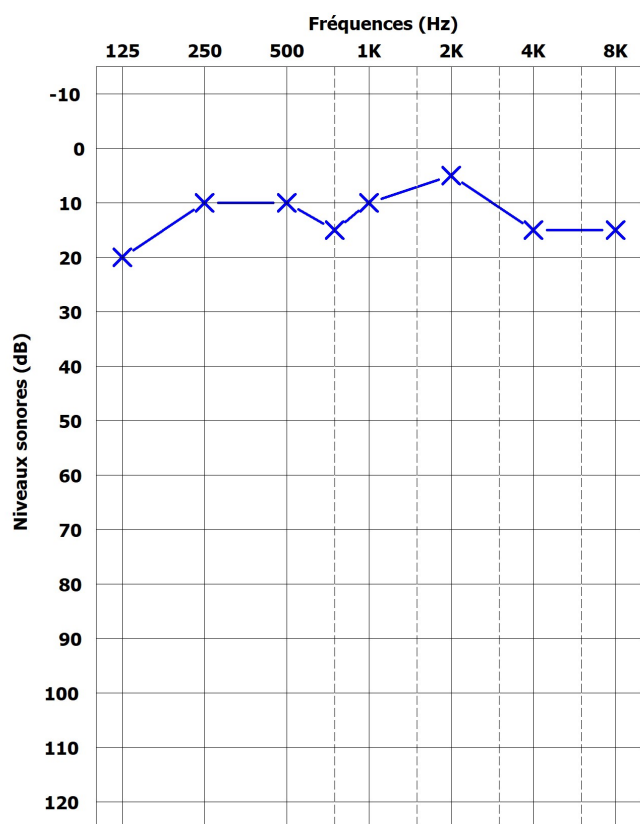

Oreille Gauche

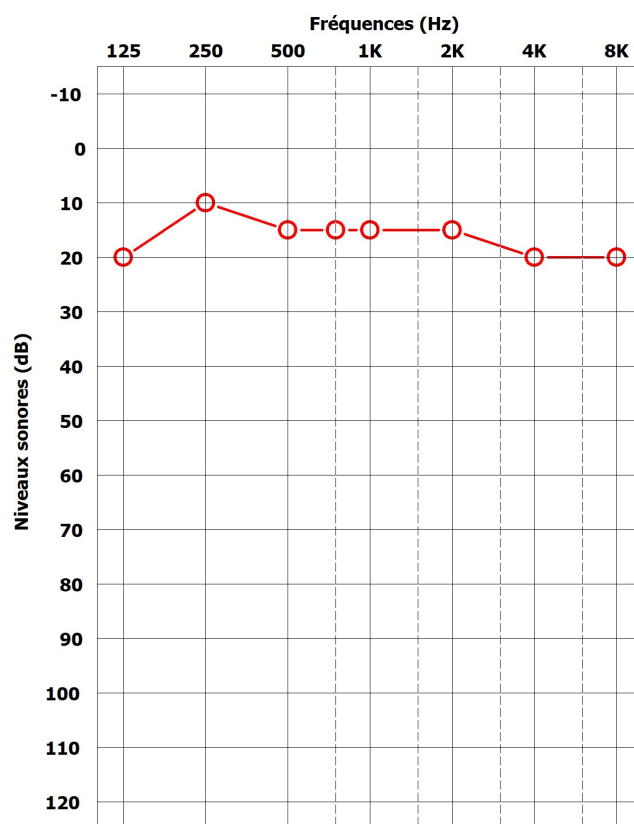

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	10	10	15	10		5		15		15
CA Droit	20	10	15	15	15		15		20		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes