


MEDVIE


Date du test: 14/03/2025 11:55:16
Durée: 3mn 52s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KEITA MOUSSA	
Date de naissance	01/01/1984
Age	41
Société	CR18
ID	25031411513425952

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

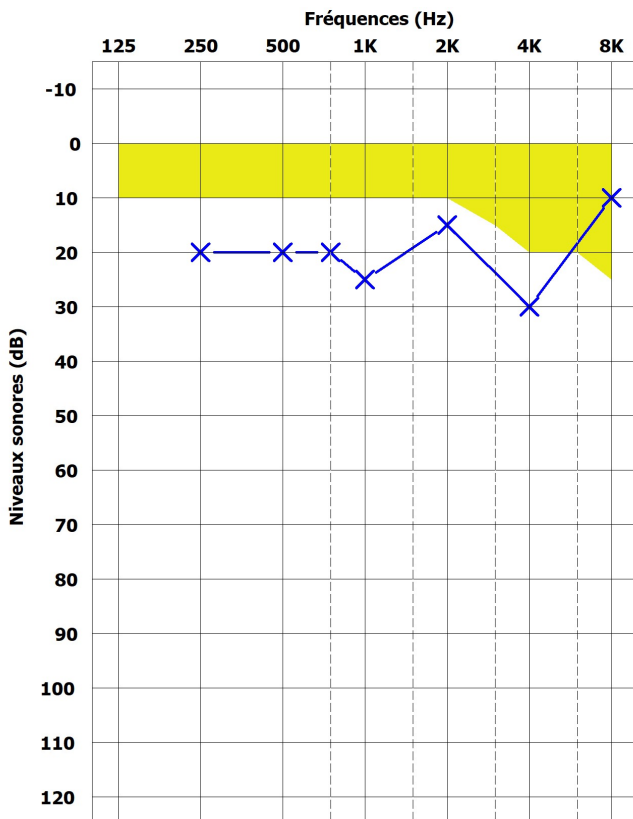

Oreille Gauche

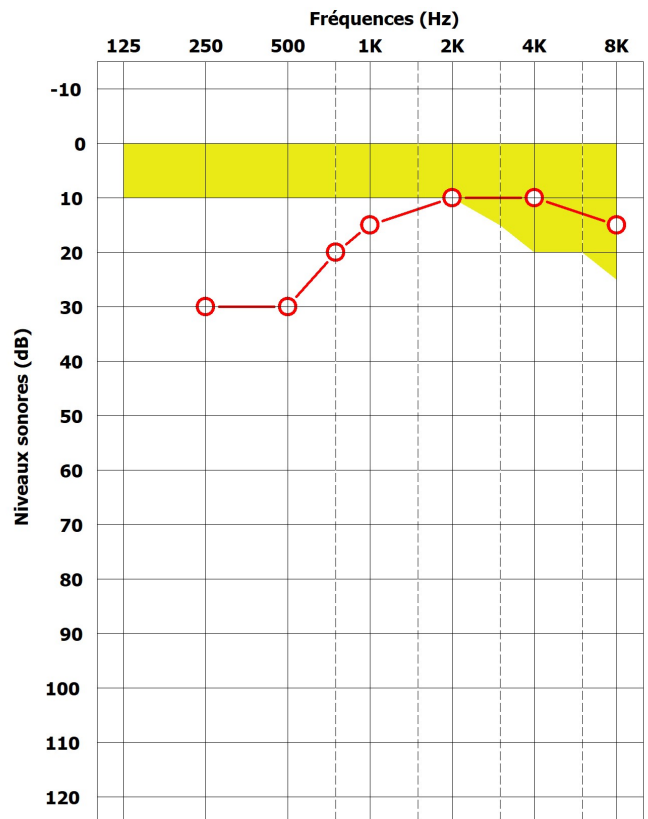

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	20	20	25		15		30		10
CA Droit		30	30	20	15		10		10		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes