


MEDVIE


Date du test: 07/08/2025 12:33:38  
Durée: 5mn 22s  
Type test: Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient   |                   |
|-------------------|-------------------|
| SIDIBE MOHAMED    |                   |
| Date de naissance | 01/01/2002        |
| Age               | 23                |
| Société           | CR18              |
| ID                | 25080712294782245 |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690092     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

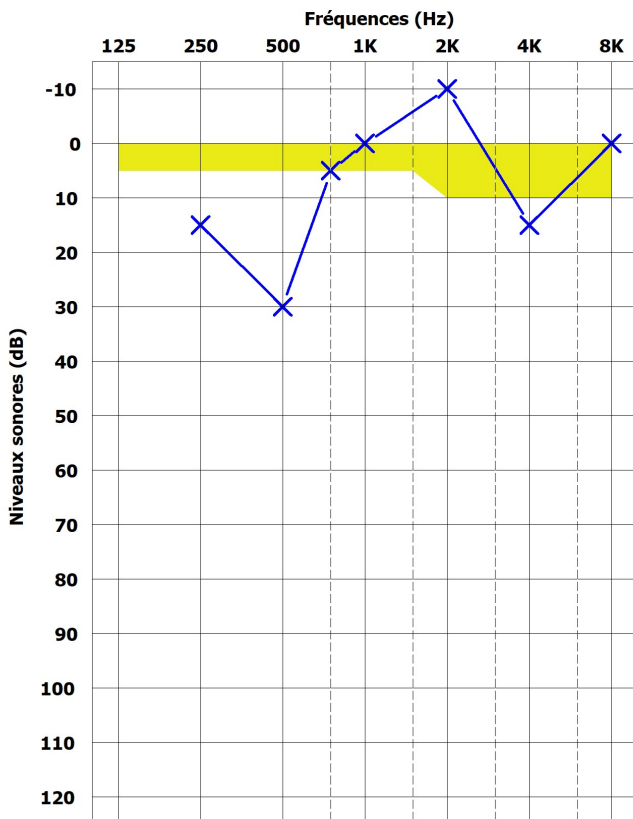

Oreille Gauche

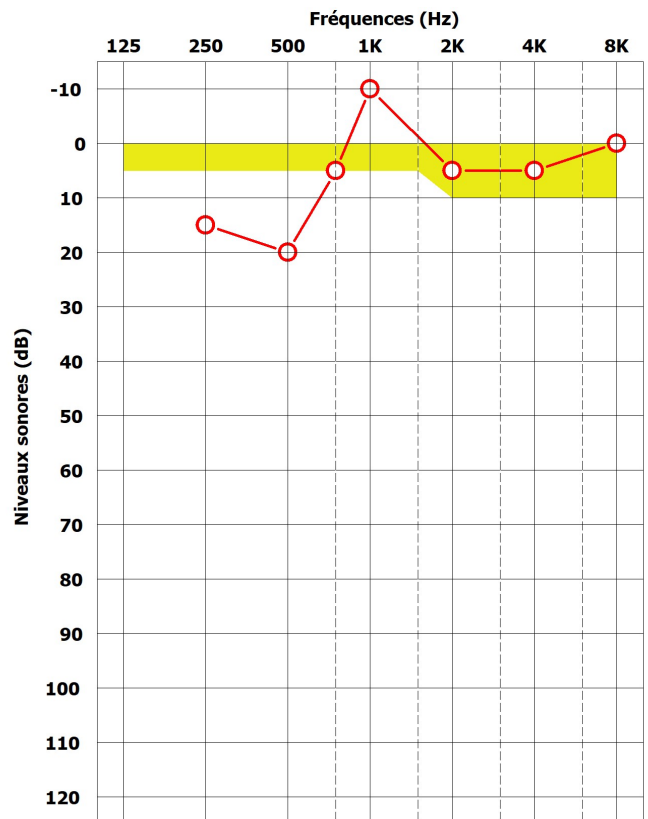

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k  | 1k5 | 2k  | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 15  | 30  | 5   | 0   |     | -10 |    | 15 |    | 0  |
| CA Droit  |     | 15  | 20  | 5   | -10 |     | 5   |    | 5  |    | 0  |

| Calcul de perte | PAM    | IPA |
|-----------------|--------|-----|
| CA Gauche       | 8,8 dB | --- |
| CA Droit        | 5,0 dB | --- |

Notes