

MEDVIE

Date du test: 02/06/2024 10:41:48

Durée: -- mn -- s

Type test Manuel

Continu

Données Patient

CAMARA SIDIKI

Date de naissance 01/01/2003

Age 21

Société CR18


ID 24060210371293882

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

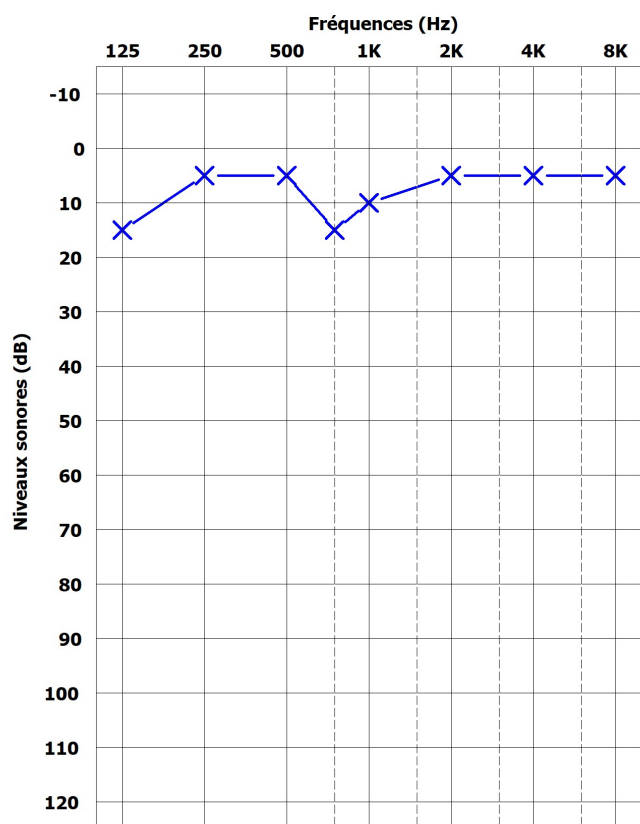

Oreille Gauche

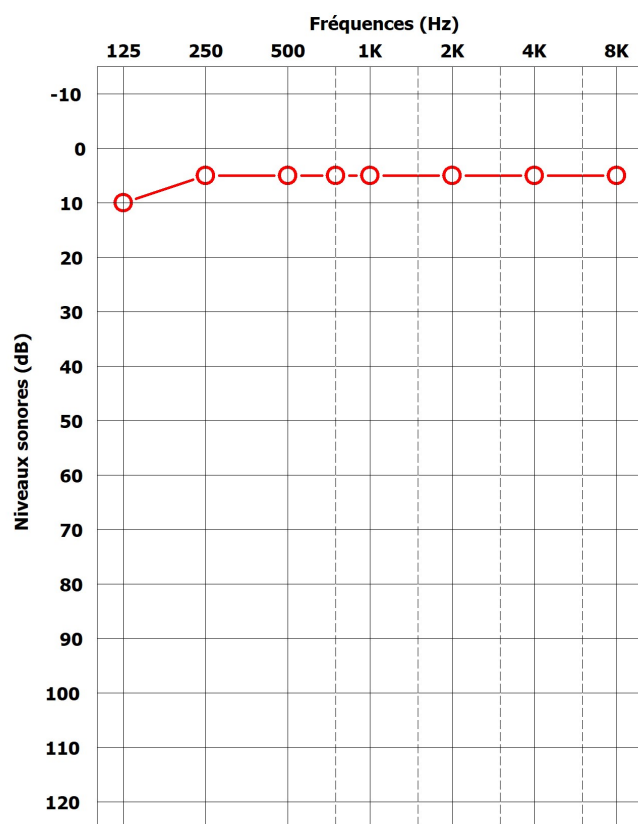

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	5	5	15	10		5		5		5
CA Droit	10	5	5	5	5		5		5		5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes