

MEDVIE


Date du test: 18/03/2025 12:44:47

Durée: 11mn 21s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CHEN YUCHENG	
Date de naissance	07/09/1971
Age	53
Société	CR18
ID	25031812431239491

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

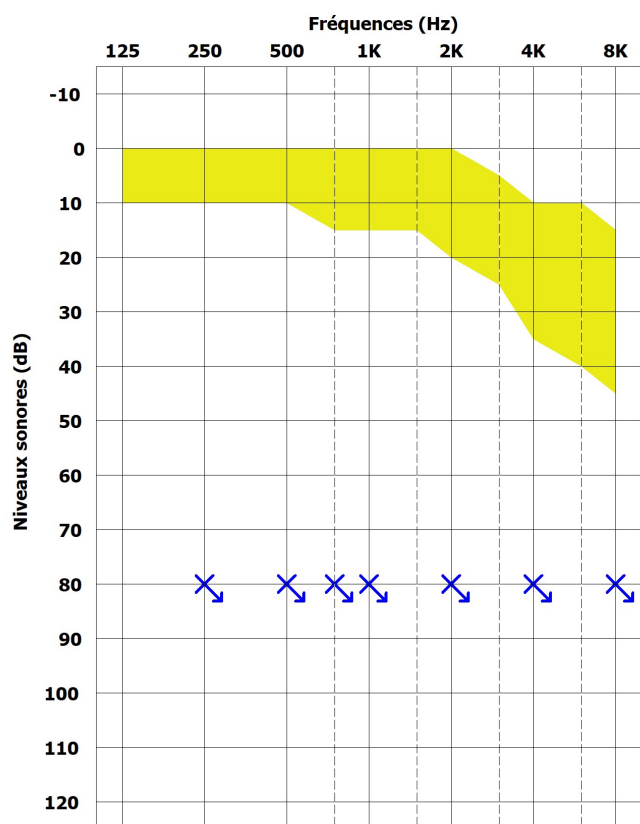

Oreille Gauche

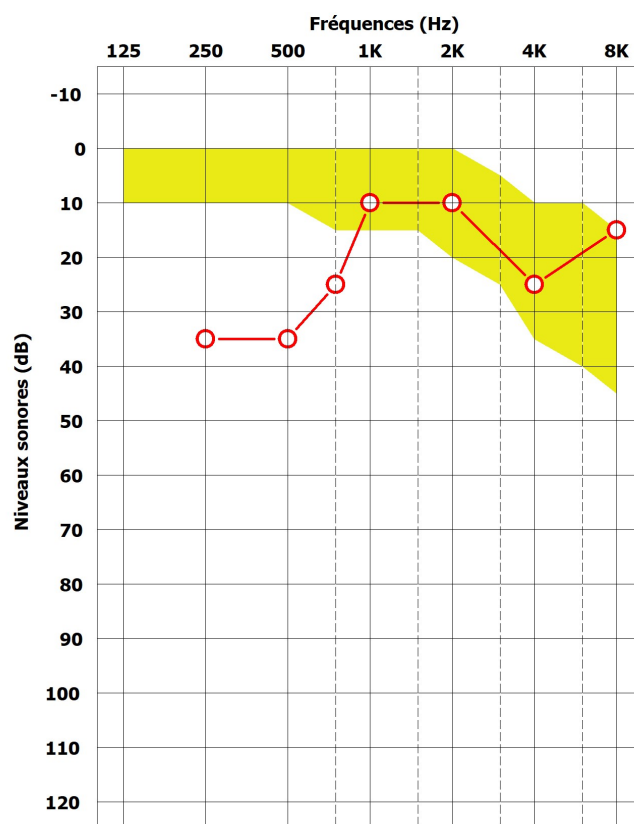

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		(80)	(80)	(80)	(80)		(80)		(80)		(80)
CA Droit		35	35	25	10		10		25		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	---	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes