


MEDVIE


Date du test: 02/08/2025 13:39:43

Durée: 5mn 38s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

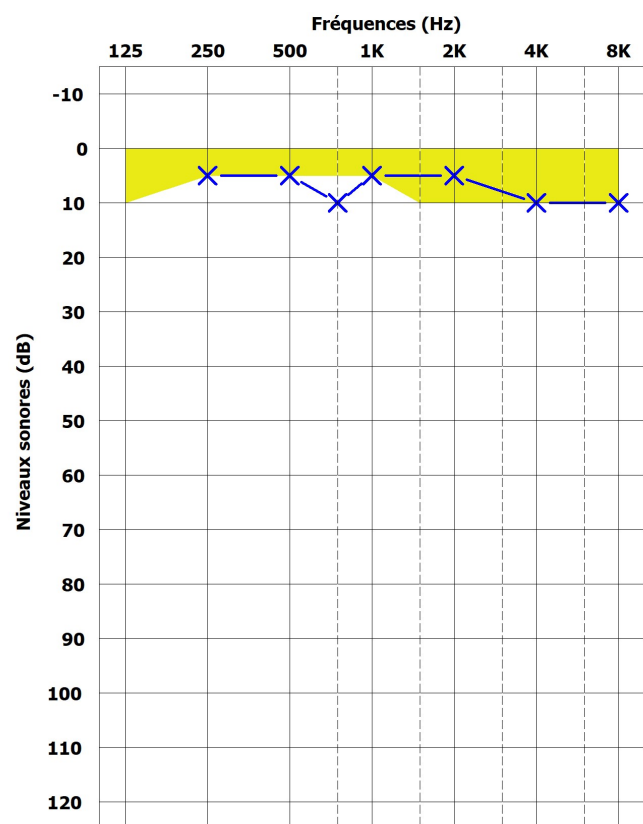

Oreille Gauche

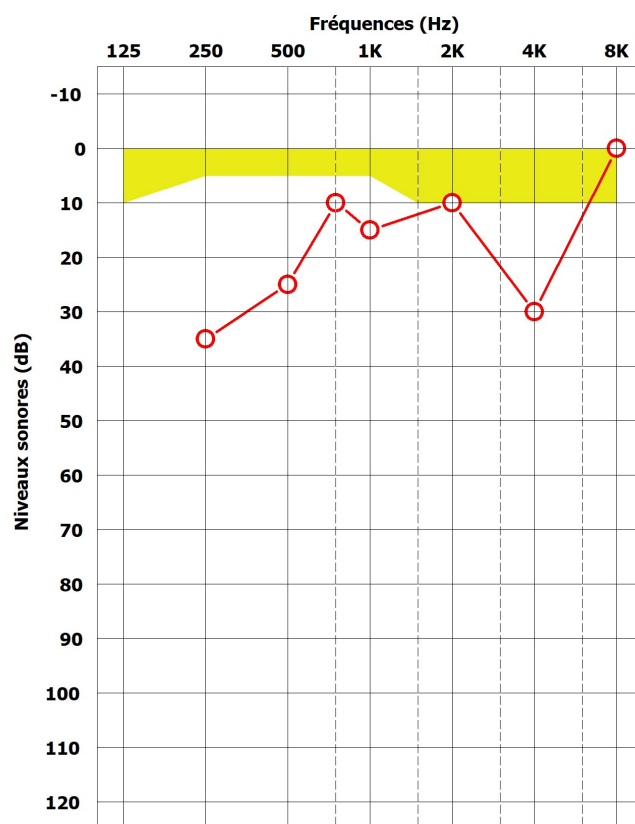

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	5	10	5		5		10		10
CA Droit		35	25	10	15		10		30		0

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes

Données Patient	SANOH MOHAMED
Date de naissance	04/02/1998
Age	27
Société	CR18
ID	25080212415736616

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021