

Données Patient


KEÏTA OUSMANE

Date de naissance 01/01/2002
Age 22
Société CR18
ID 24050609024433396


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 06/05/2024 09:09:24
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

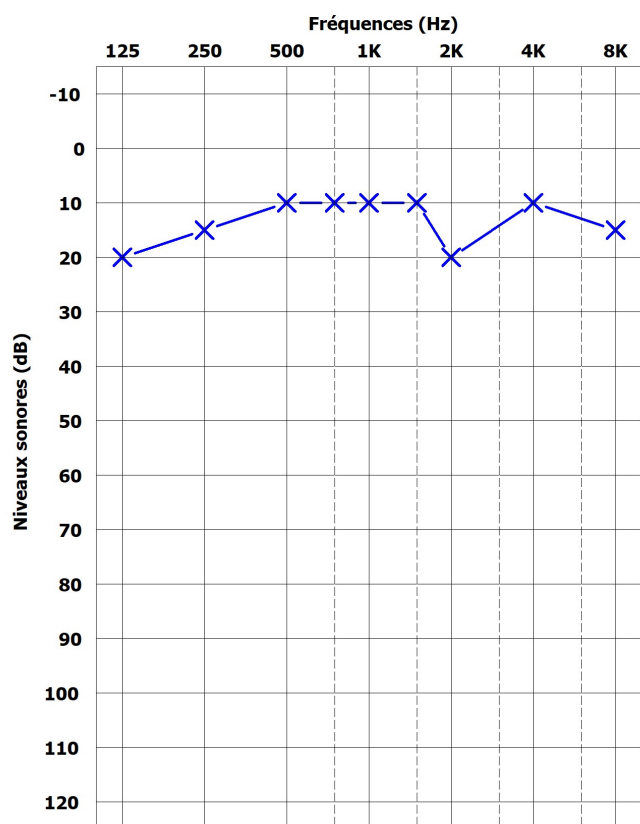

Oreille Gauche

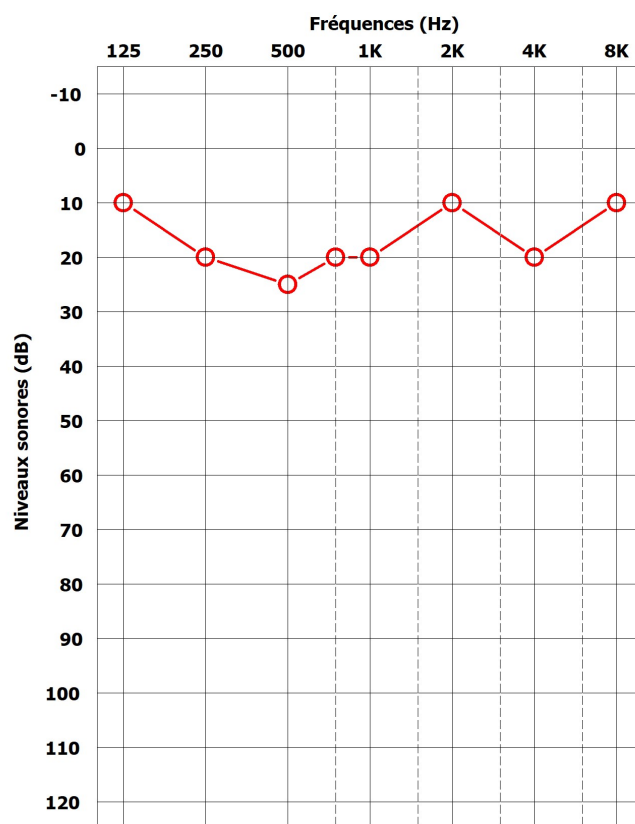

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	15	10	10	10	10	20		10		15
CA Droit	10	20	25	20	20		10		20		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes