

MEDVIE


Date du test: 01/05/2024 18:06:17

Durée: 10mn 14s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	SACKO MOHAMED
Date de naissance	01/01/1994
Age	30
Société	CR18
ID	24050118012370774

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

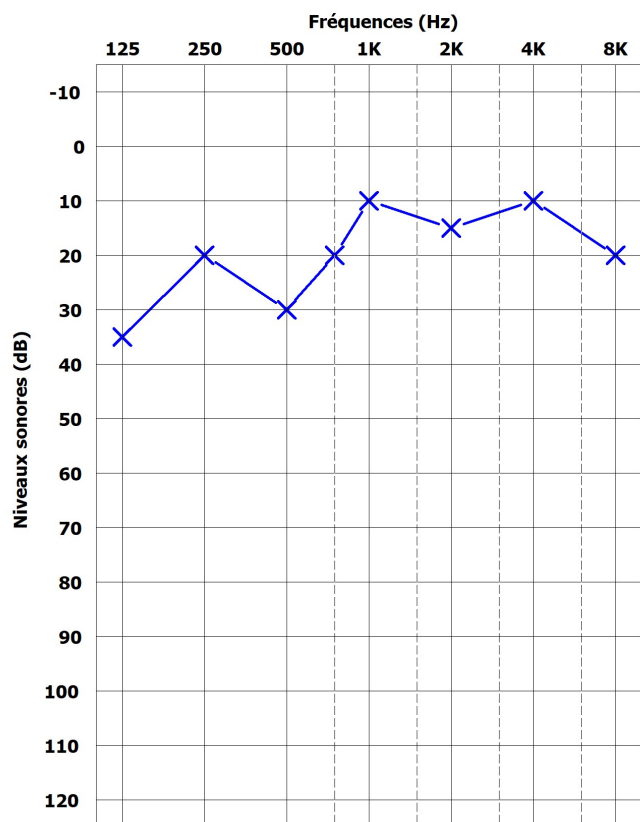

Oreille Gauche

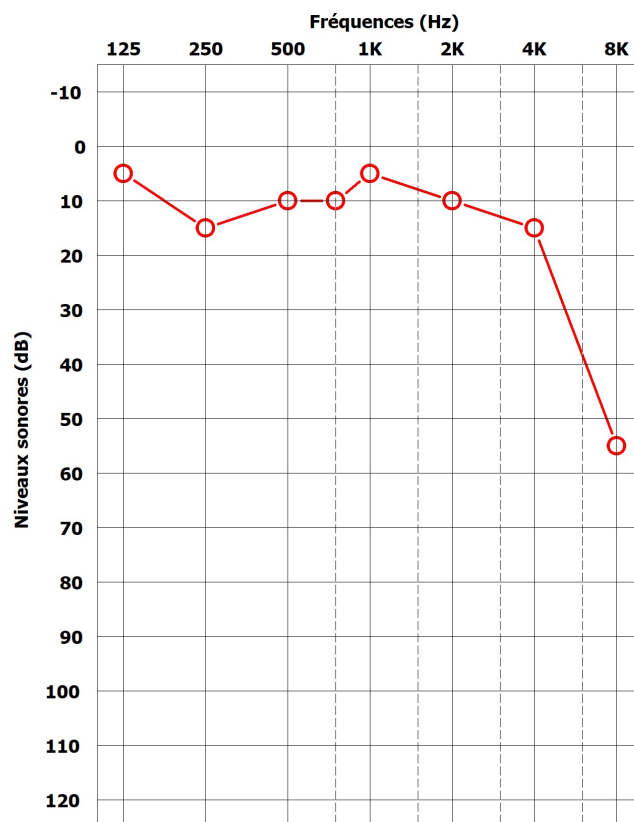

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	35	20	30	20	10		15		10		20
CA Droit	5	15	10	10	5		10		15		55

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes