

MEDVIE


Date du test: 02/08/2025 13:52:39

Durée: 7mn 01s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		KONATE FAKOUMAN
Date de naissance	01/01/2000	
Age	25	
Société	CR18	
ID	25080213491591826	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

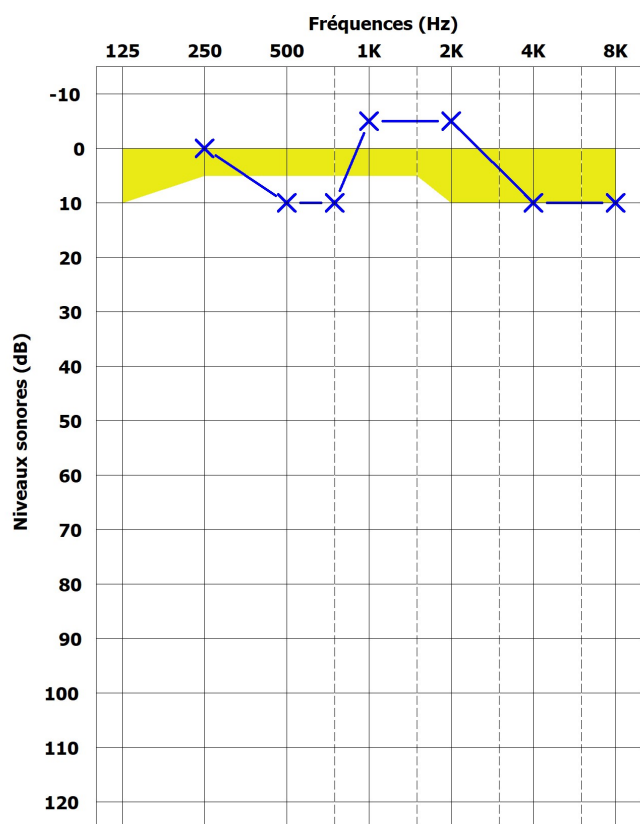

Oreille Gauche

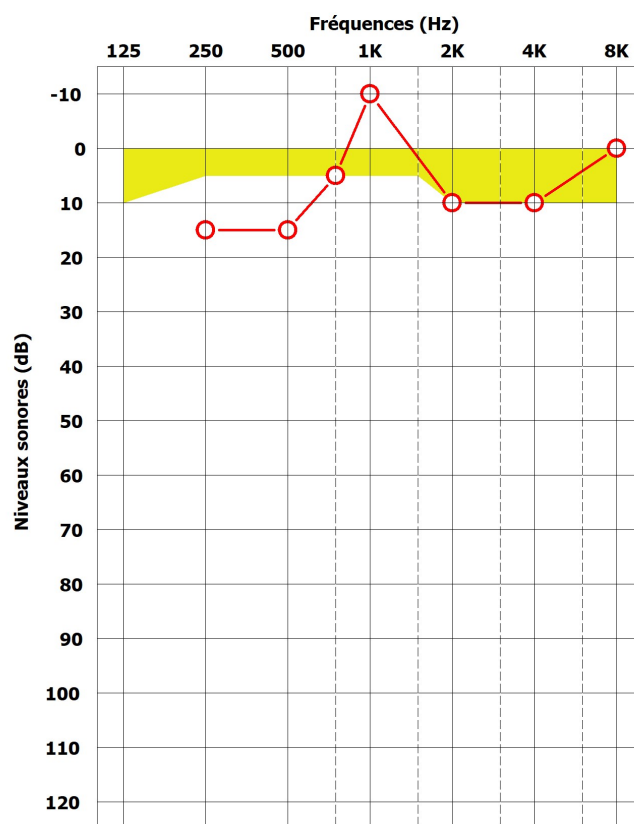

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	10	10	-5		-5		10		10
CA Droit		15	15	5	-10		10		10		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	2,5 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes