


MEDVIE


Date du test: 11/03/2025 12:37:26

Durée: 4mn 23s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

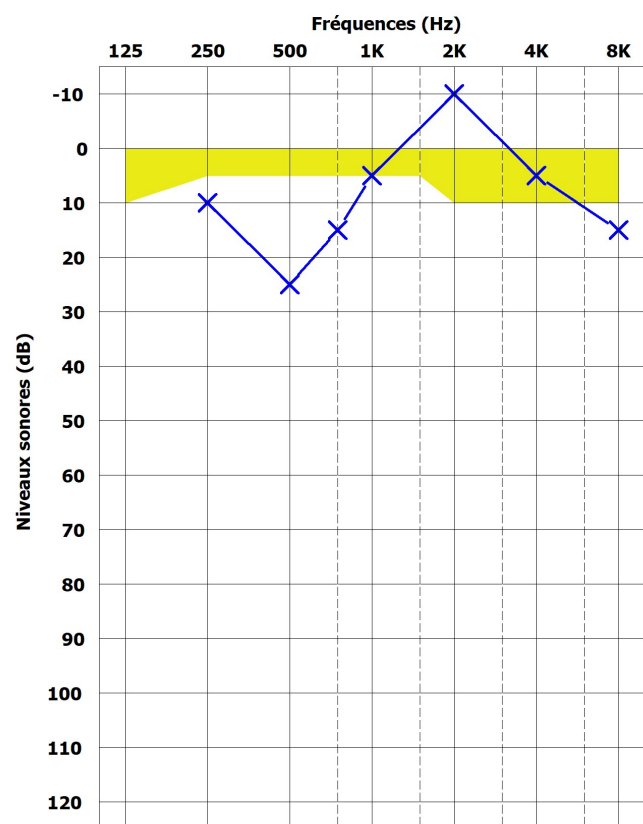

Oreille Gauche

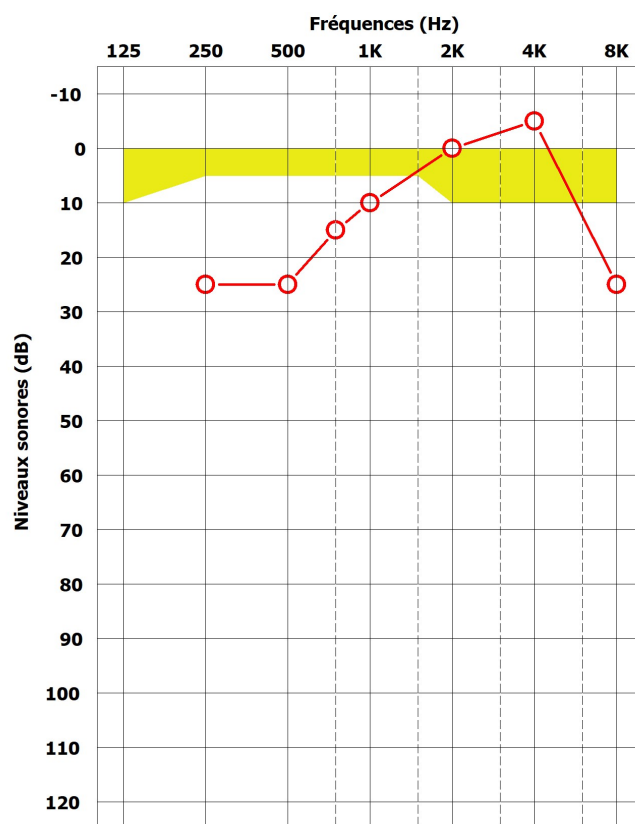

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	25	15	5		-10		5		15
CA Droit		25	25	15	10		0		-5		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes

Données Patient	CAMARA Namory
Date de naissance	05/08/1999
Age	25
Société	CR18
ID	25031112341534772

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021