



Données Patient	
LAMAH SENY ELISABETH	
Date de naissance	01/01/1993
Age	31
Société	CR18
ID	24060110241949586

Date du test: 01/06/2024 10:30:24
 Durée: -- mn -- s
 Type test Manuel
 Continu

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

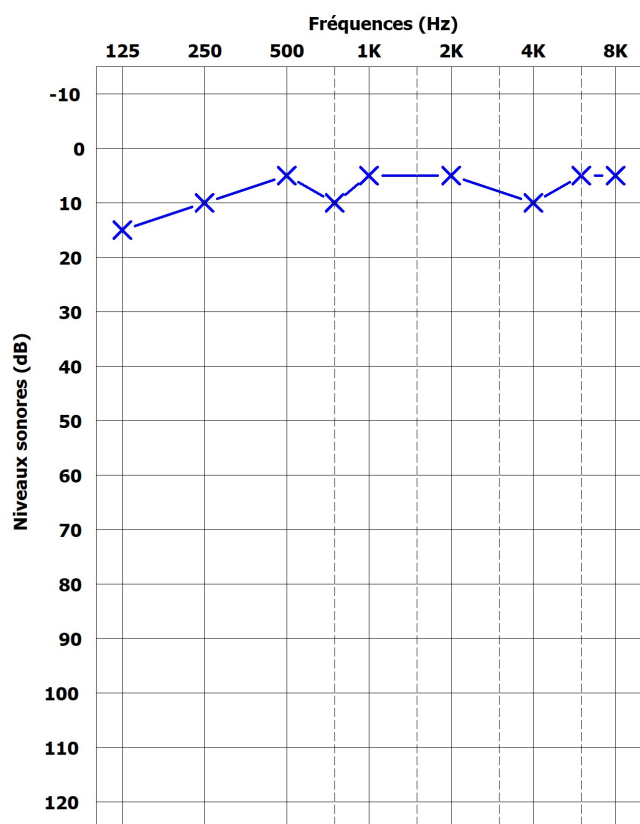

Oreille Gauche

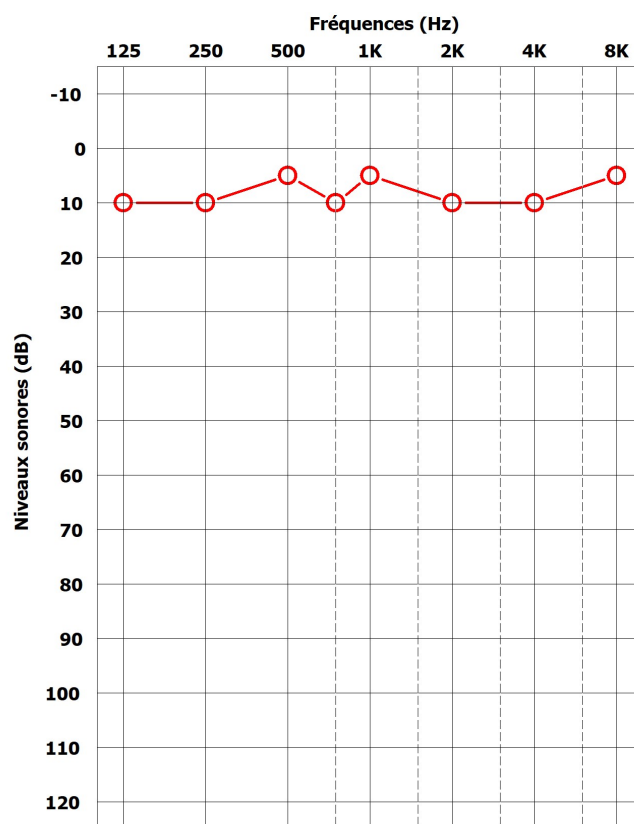

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	10	5	10	5		5		10	5	5
CA Droit	10	10	5	10	5		10		10		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes