

MEDVIE BEYLA


Date du test: 18/12/2024 13:51:48

Durée: 6mn 16s


Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient   |                   |
|-------------------|-------------------|
| KEITA OUSMANE     |                   |
| Date de naissance | 02/02/2000        |
| Age               | 24                |
| Société           | CR18              |
| ID                | 24121813454758246 |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690093     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

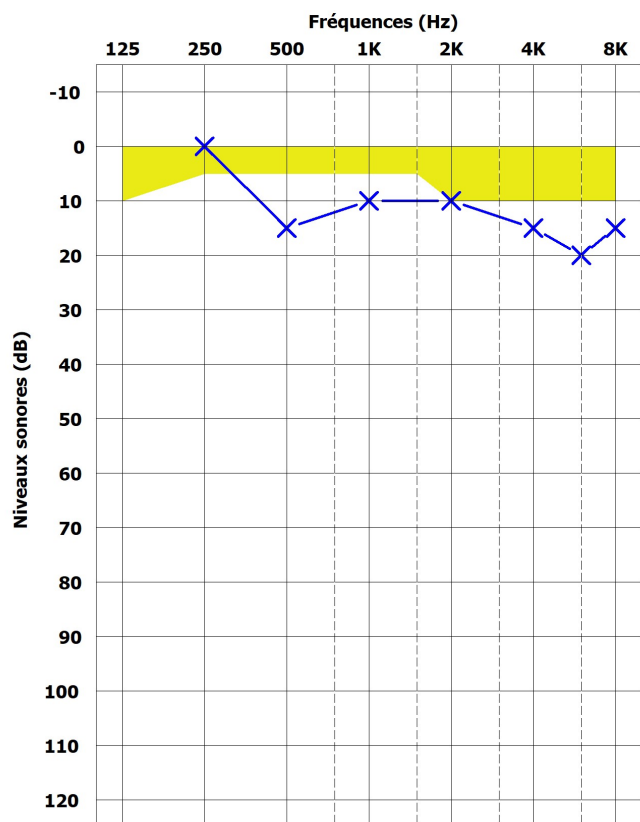

Oreille Gauche

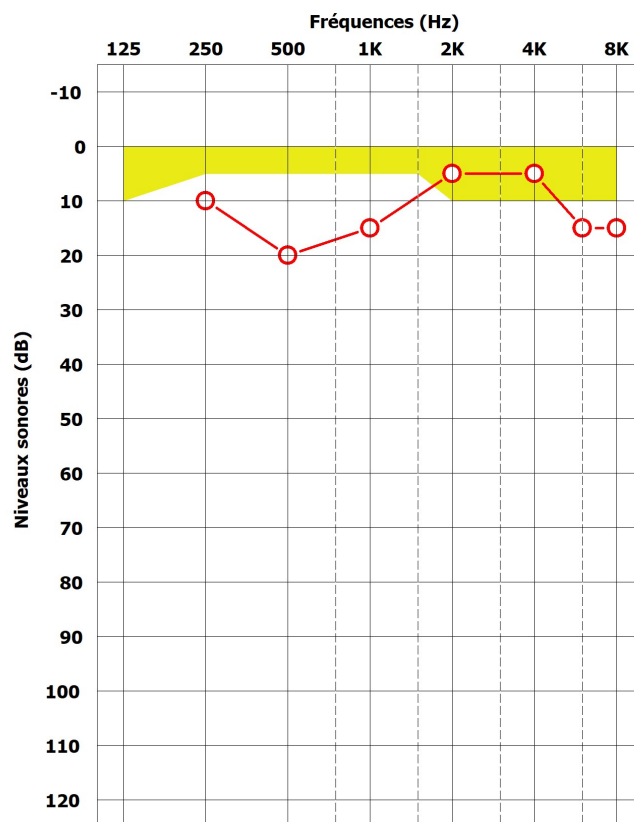

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 0   | 15  |     | 10 |     | 10 |    | 15 | 20 | 15 |
| CA Droit  |     | 10  | 20  |     | 15 |     | 5  |    | 5  | 15 | 15 |

| Calcul de perte |         |
|-----------------|---------|
|                 | PAM     |
| CA Gauche       | 10,0 dB |
| CA Droit        | 15,0 dB |

Notes