



Données Patient


KOUROUMA N'FALY

Date de naissance 01/01/1994
Age 31
Société CR18
ID 25031011435331889


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 10/03/2025 11:48:07
Durée: 4mn 21s
Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

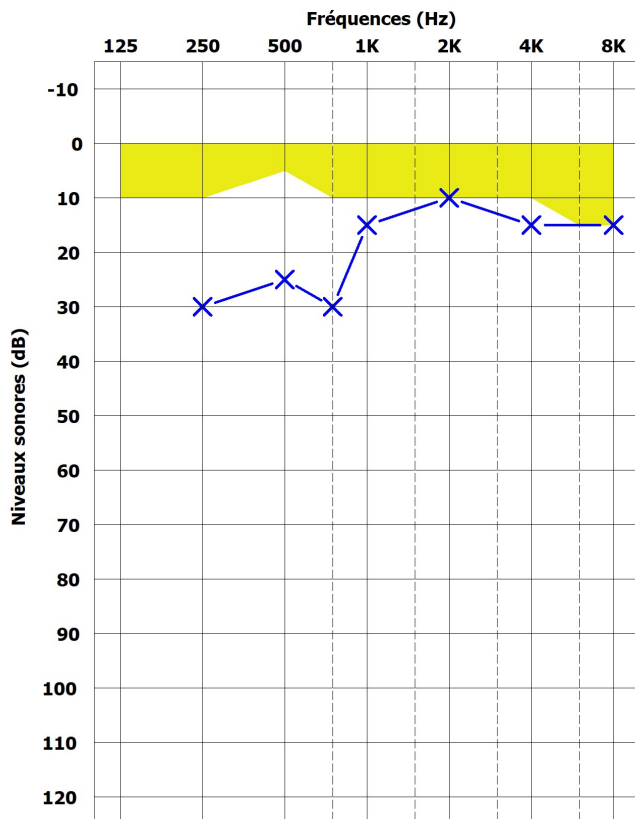

Oreille Gauche

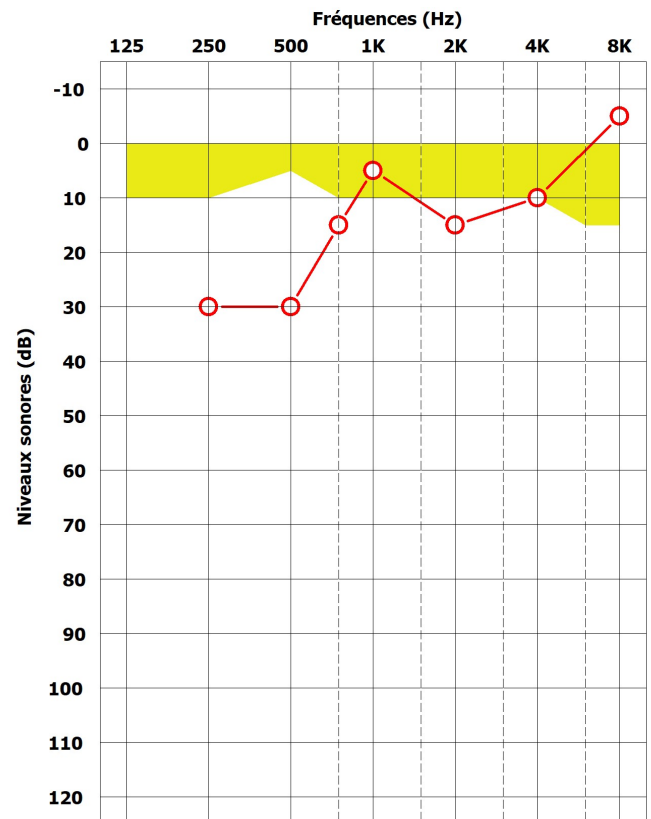

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	25	30	15		10		15		15
CA Droit		30	30	15	5		15		10		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes