


MEDVIE


Date du test: 20/05/2024 15:15:03
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	
KOUROUMA KEMO	
Date de naissance	05/10/2004
Age	19
Société	CR18
ID	24052015111093411

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

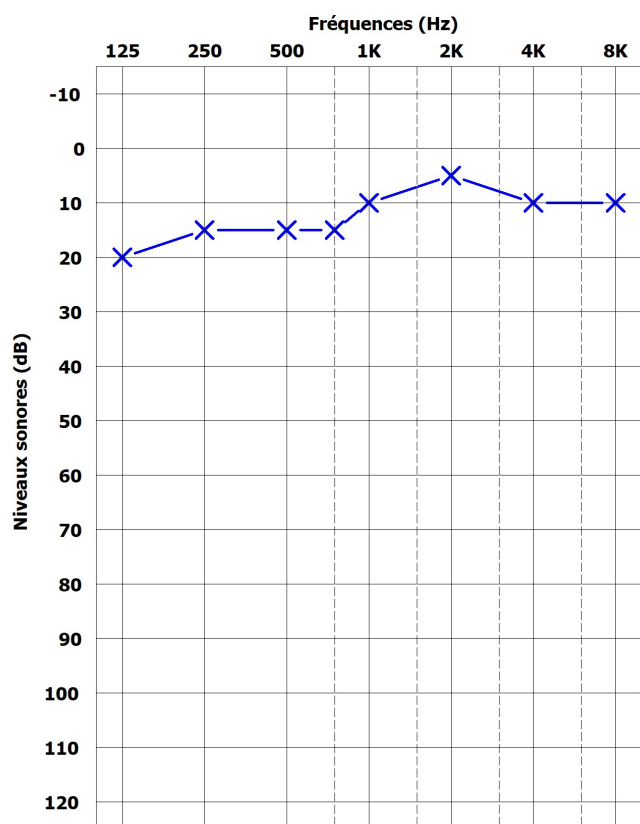

Oreille Gauche

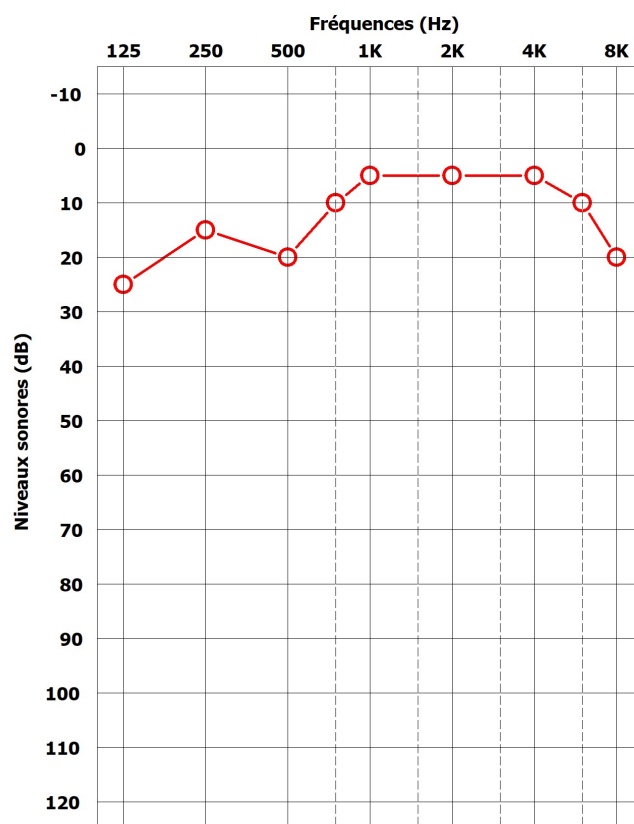

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	15	15	15	10		5		10		10
CA Droit	25	15	20	10	5		5		5	10	20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes